


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

|      |               |     |         |        |         |
|------|---------------|-----|---------|--------|---------|
| メーカー | オークマ          | 年式  | 2014.11 | 管理番号   | P009080 |
| 型式   | MILLAC-561VII | 測定者 | 金子      | アシスタント |         |

## 振り回し(300ピッチ)

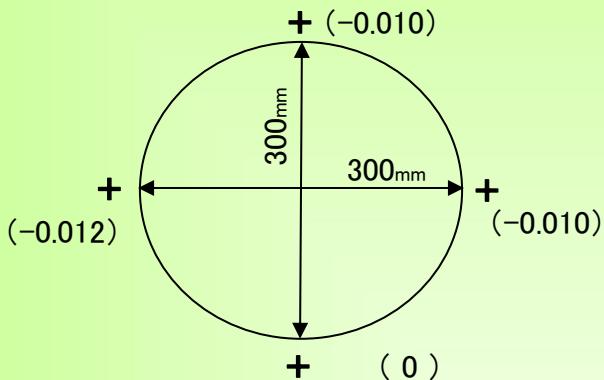


## 主軸振れ

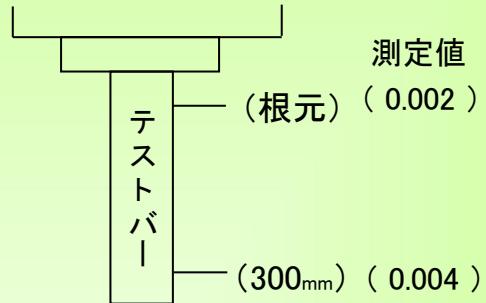


## 直角度

【YZ】測定値 (0.006)

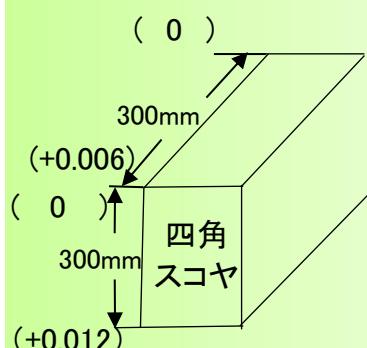

【XZ】測定値 (0.002)

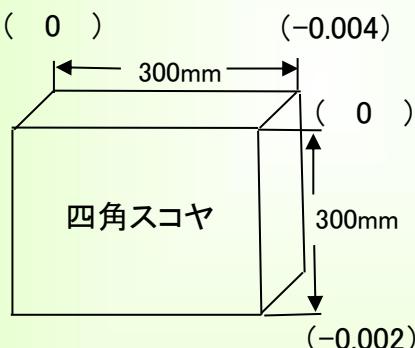


【XY】測定値 (0.006)



## 上面精度

※テーブルサイズ 1350×560

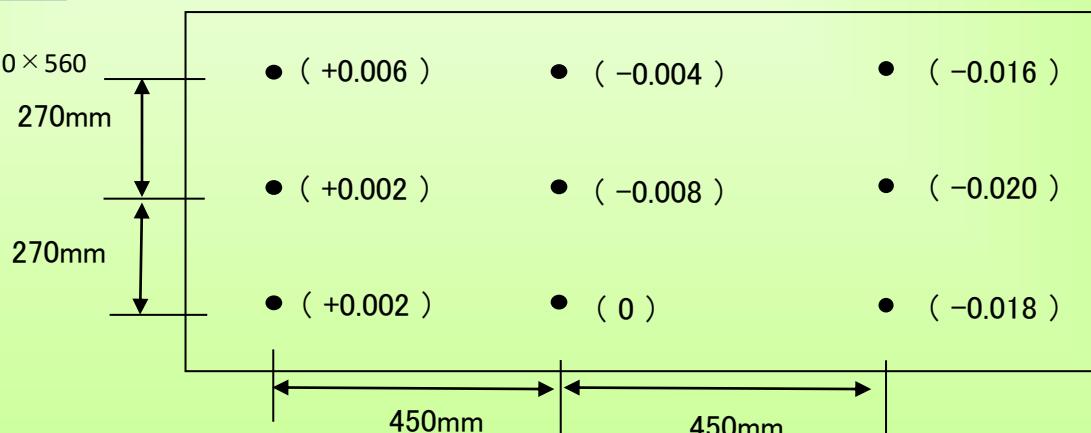

2025/12/9