


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2003	管理番号	P009080
型式	MILLAC-761V	測定者	長谷川	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

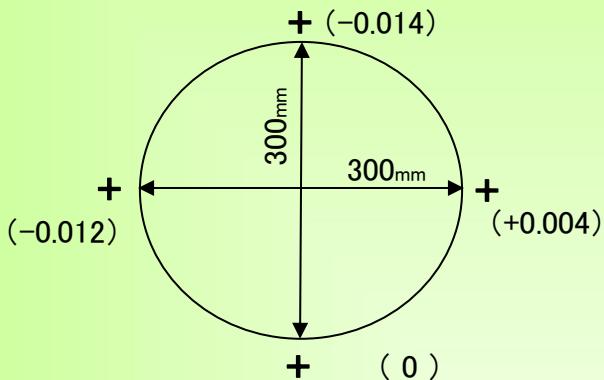


主軸振れ

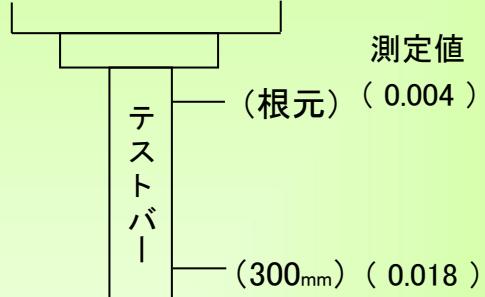


直角度


【YZ】測定値 (0.004)

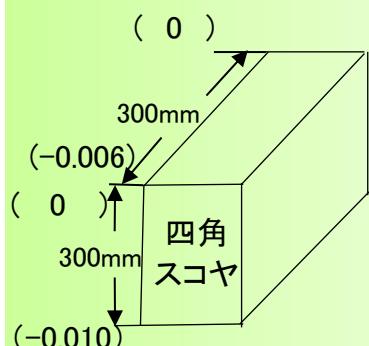

【XZ】測定値 (0.002)

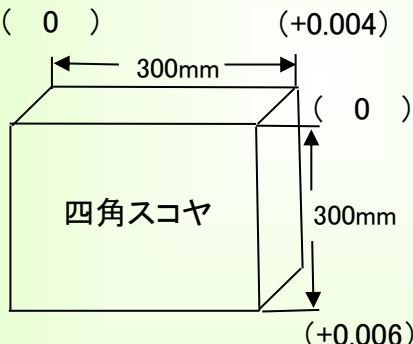


【XY】測定値 (0.008)

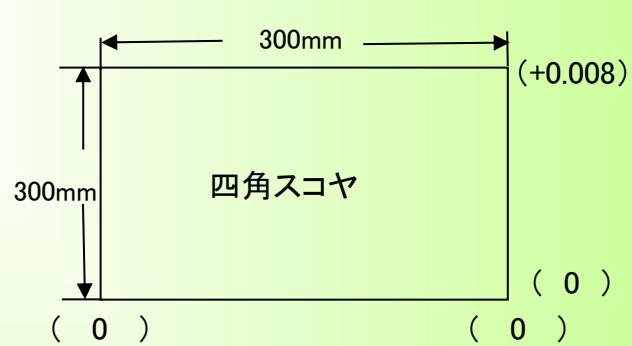

上面精度

※テーブルサイズ 1800×720

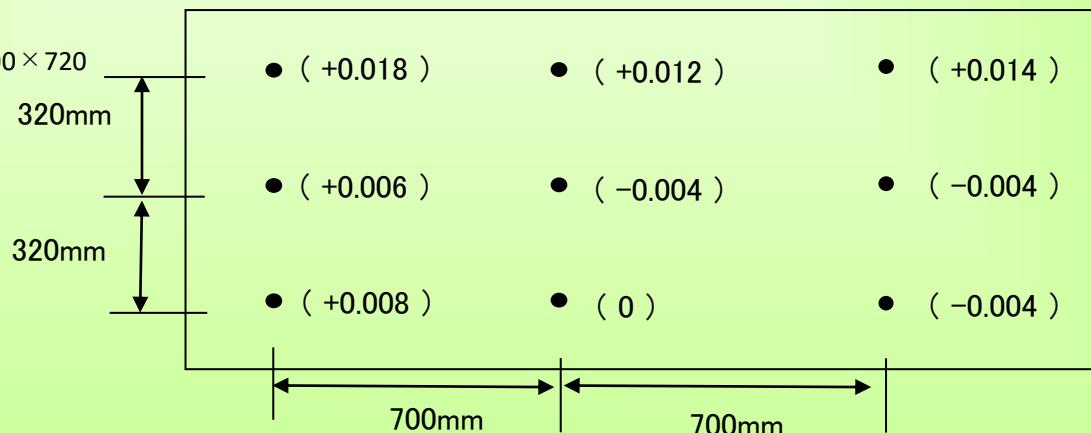

2025/12/12