


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2015	管理番号	H019415
型式	VM76R	測定者	仙田	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

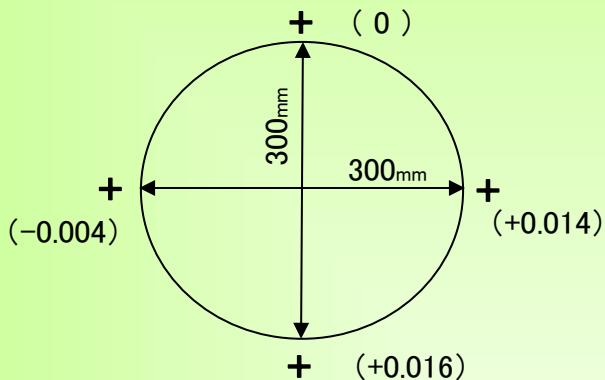


主軸振れ

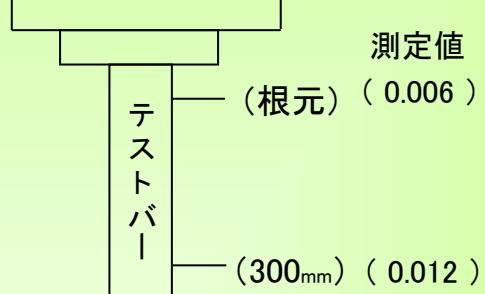


直角度

【YZ】測定値 (0.014)

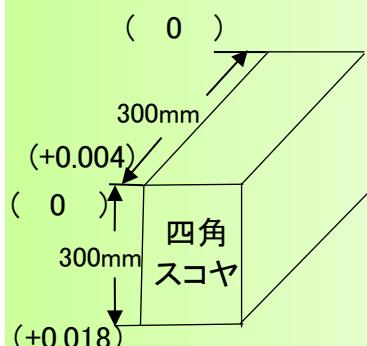

【XZ】測定値 (0.014)

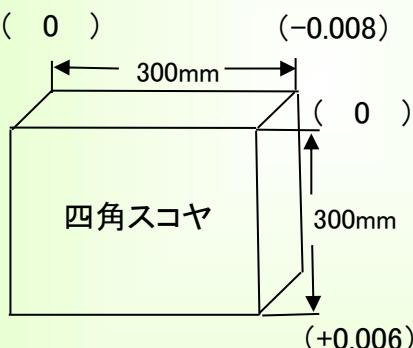


【XY】測定値 (0.012)



上面精度

※テーブルサイズ 760×1550

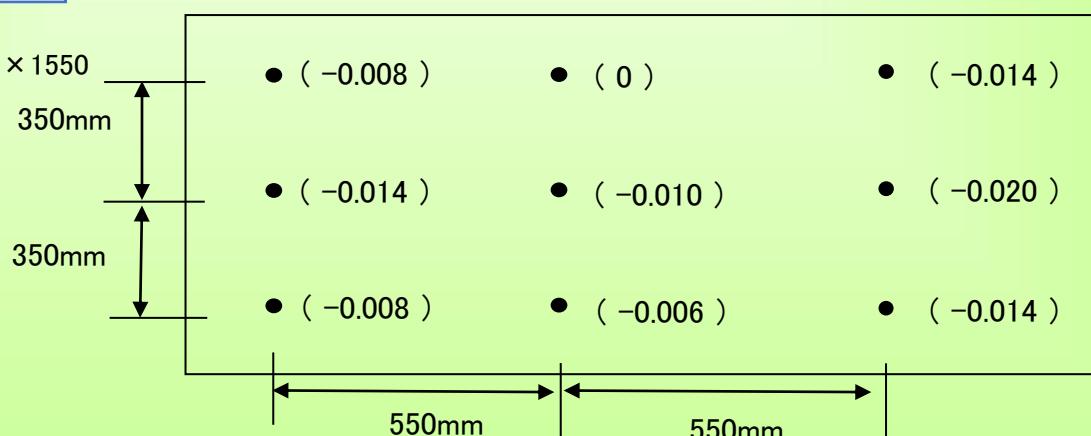

2025/9/27