


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	エツキ	年式	2013	管理番号	H019693
型式	MS-V	測定者	山口	アシスタント	

## 振り回し(150ピッチ)

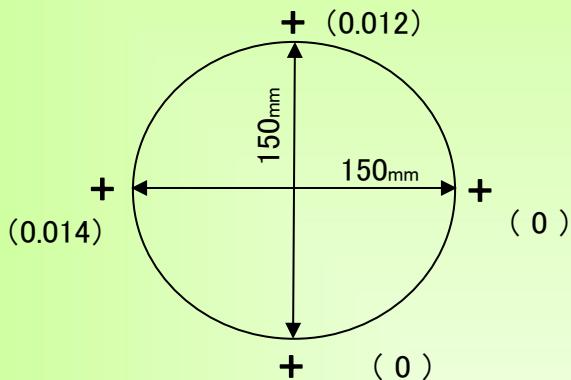


## 主軸振れ

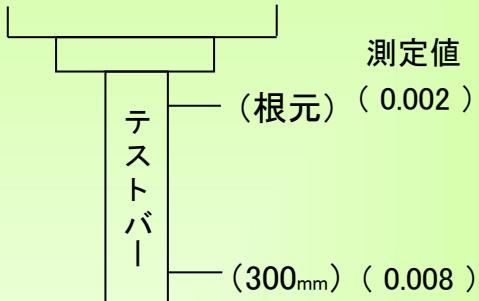


## 直角度


【YZ】測定値 (0.022)

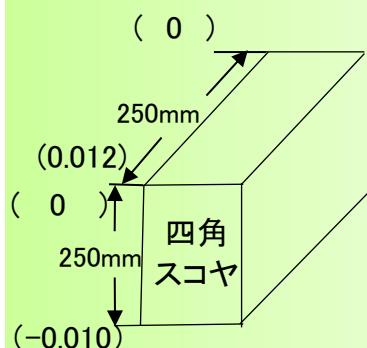

【XZ】測定値 (0.008)

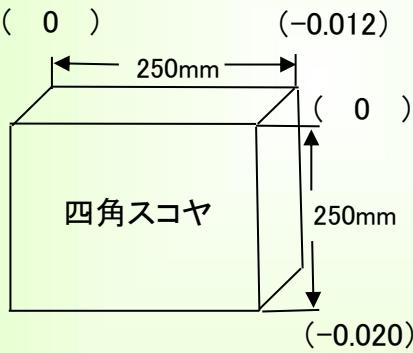


【XY】測定値 (0.020)

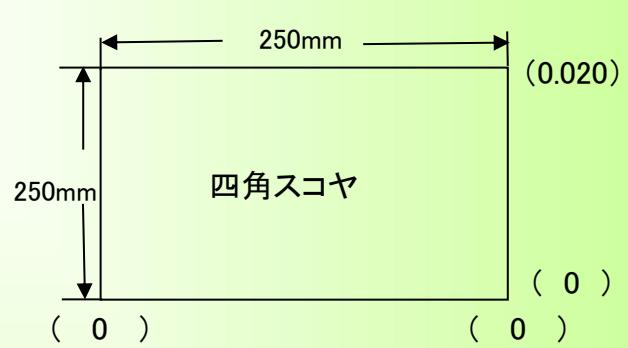

## 上面精度

※テーブルサイズ 1100×270

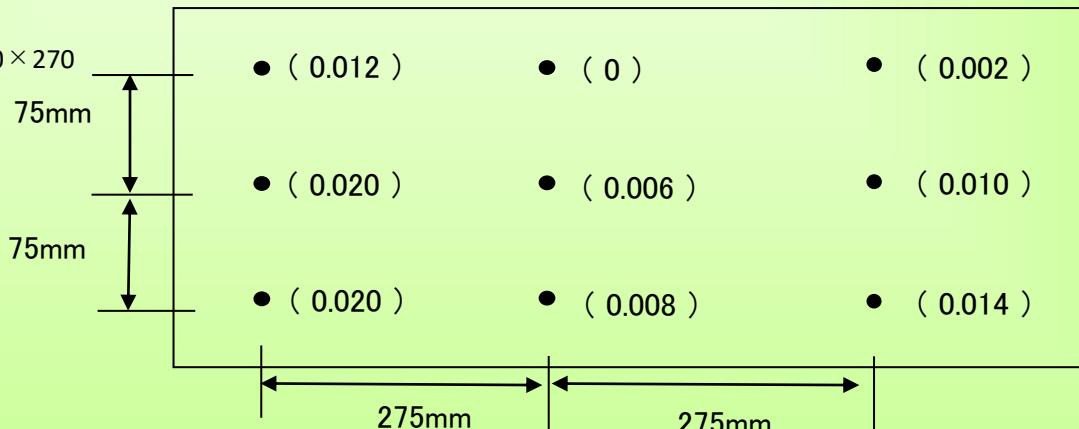

2026/1/13