


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	エツキ	年式	2016	管理番号	H019695
型式	MS-V	測定者	山口	アシスタント	

振り回し(150ピッチ)

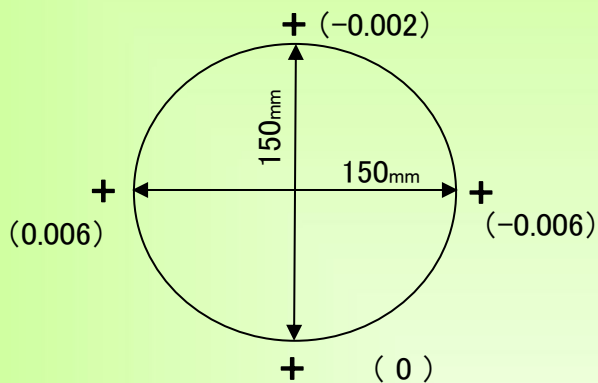

主軸振れ



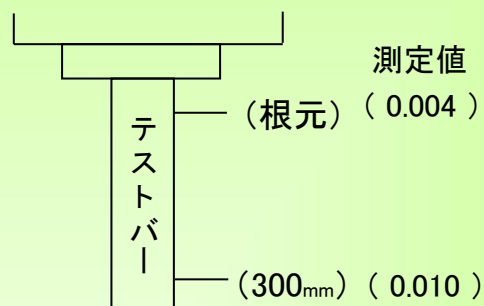


直角度

【YZ】 測定値 (0.006)


【XZ】 測定値 (0.008)

【X Y】 測定値 (0.010)

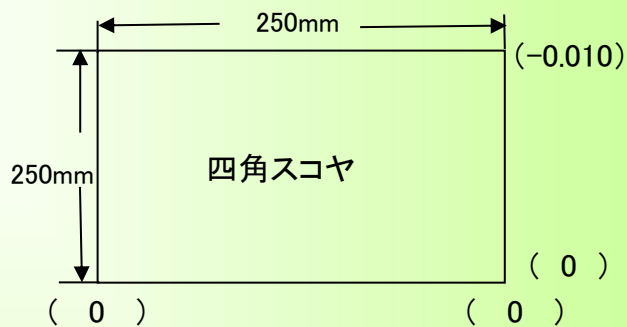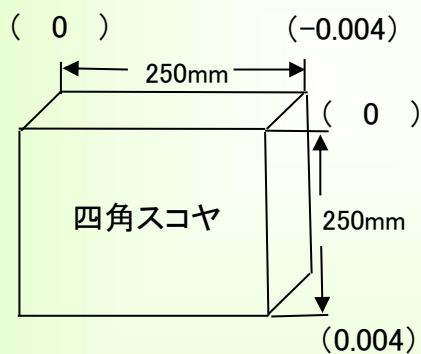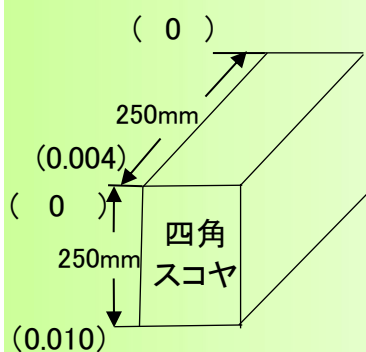

上面精度

※テーブルサイズ 1100×270

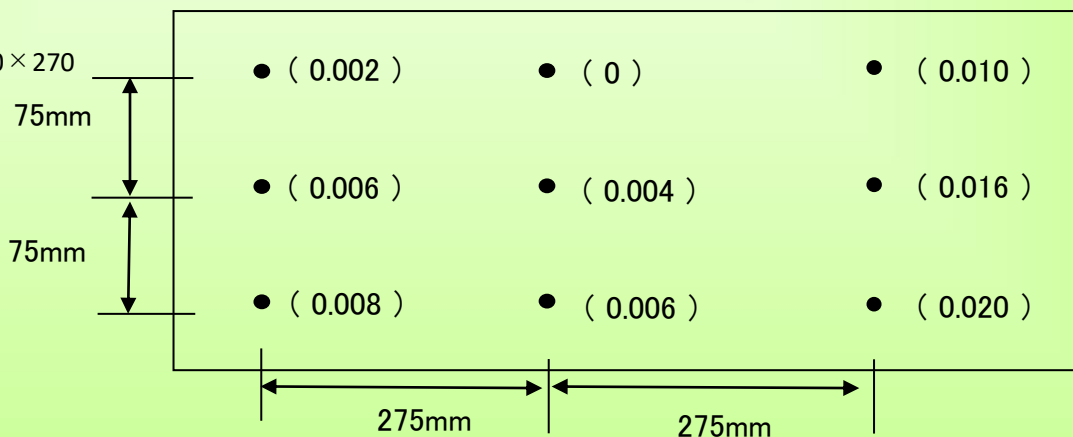

2026/1/13