


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	キタムラ機械	年式	2006	管理番号	P009016
型式	Mycenter-3XiF	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

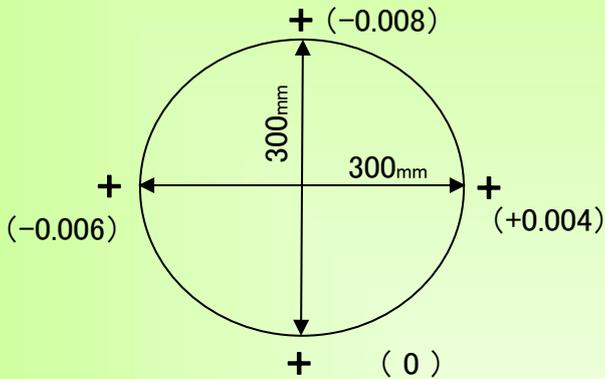

主軸振れ



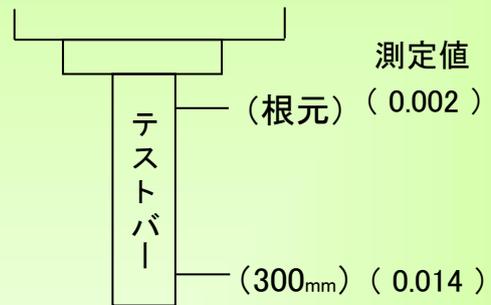


直角度

【YZ】 測定値 (0.016)


【XZ】 測定値 (0.020)

【XY】 測定値 (0.004)

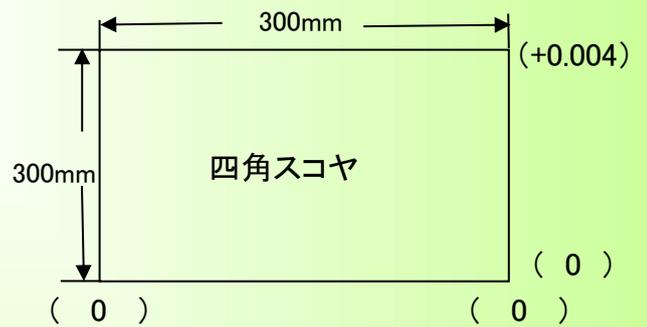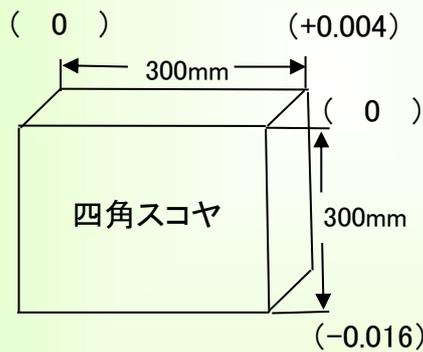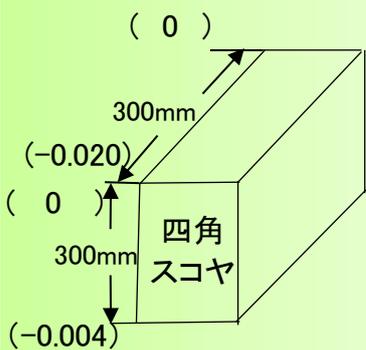

上面精度

※テーブルサイズ 900×410

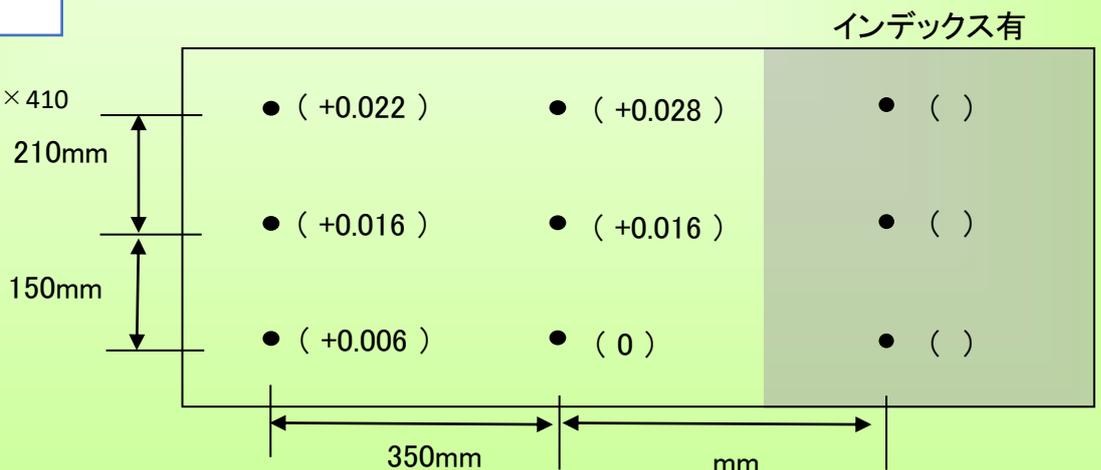

2026/1/20