


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	キタムラ機械	年式	2006	管理番号	P009017
型式	Mycenter-3XiF	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

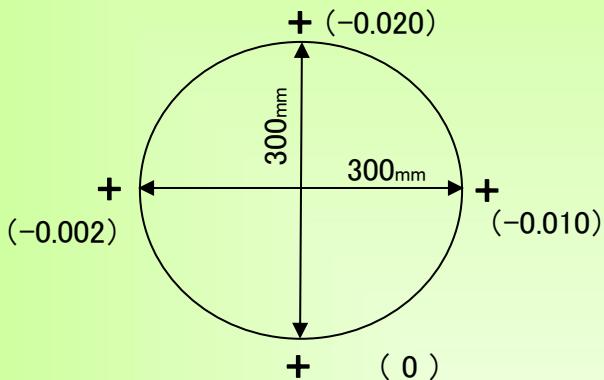


主軸振れ

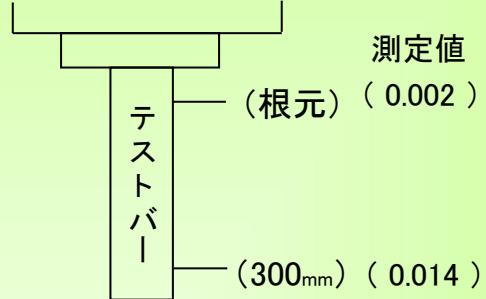


直角度


【YZ】測定値 (0.006)

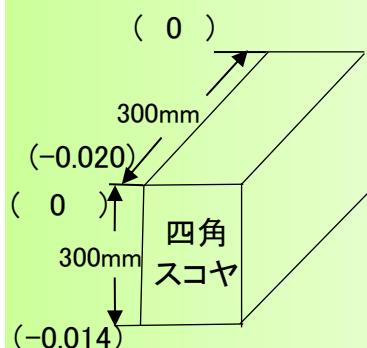

【XZ】測定値 (0.020)

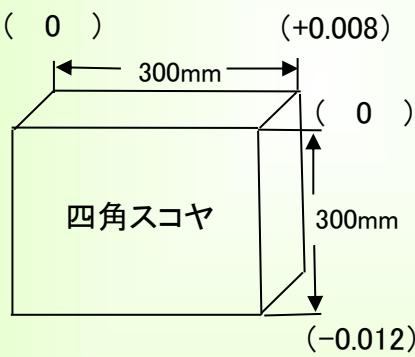


【XY】測定値 (0.006)

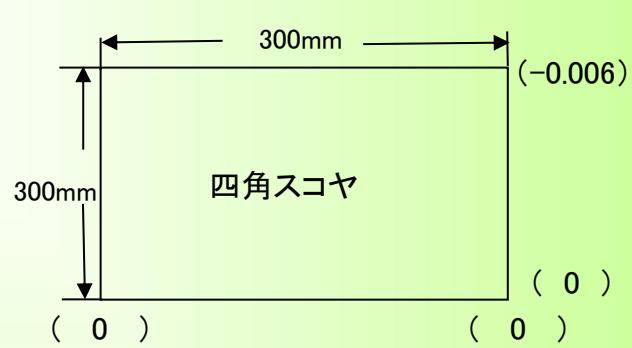

上面精度

※テーブルサイズ 900×410

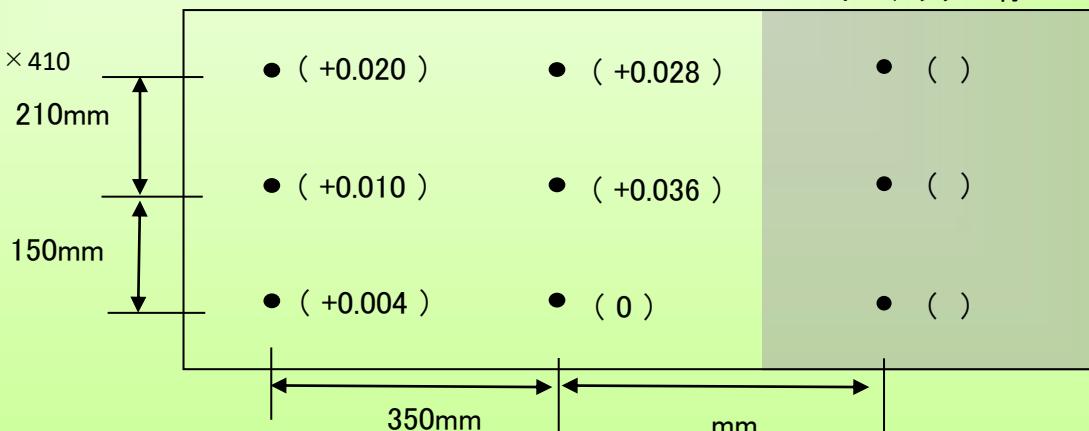

2026/1/20

インデックス有