


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	キタムラ機械	年式	2008	管理番号	P009018
型式	Mycenter-3XiF	測定者	武藤	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

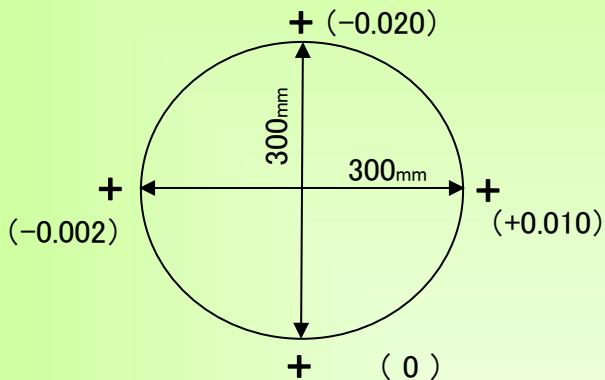


## 主軸振れ

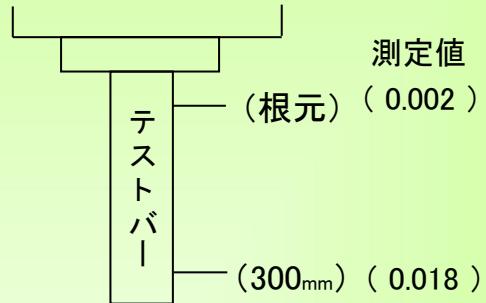


## 直角度


【YZ】測定値 (0.016)

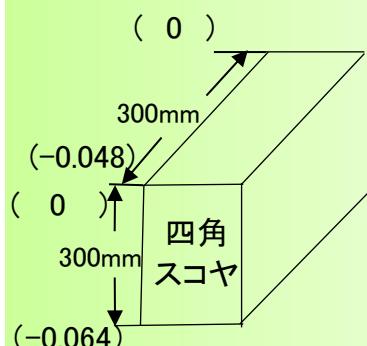

【XZ】測定値 (0.028)

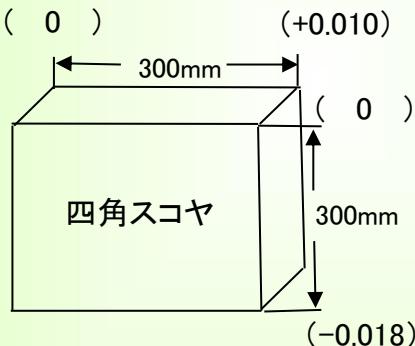


【XY】測定値 (0.008)

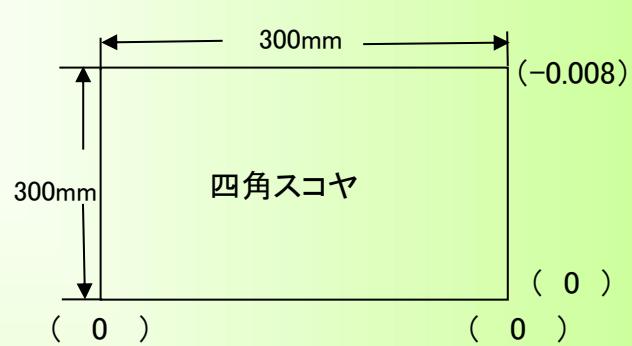

## 上面精度

※テーブルサイズ 900×410

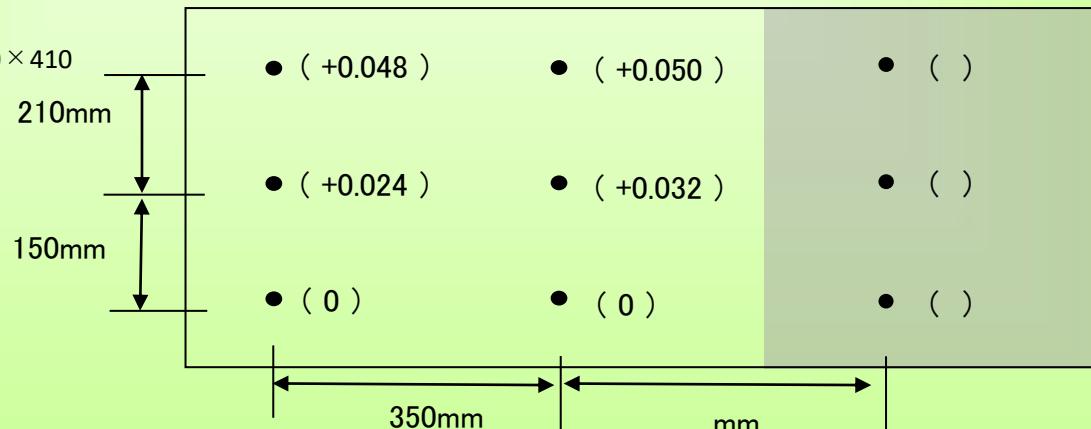

2026/1/20