


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2006	管理番号	P009002
型式	NV5000 α 1A/40	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

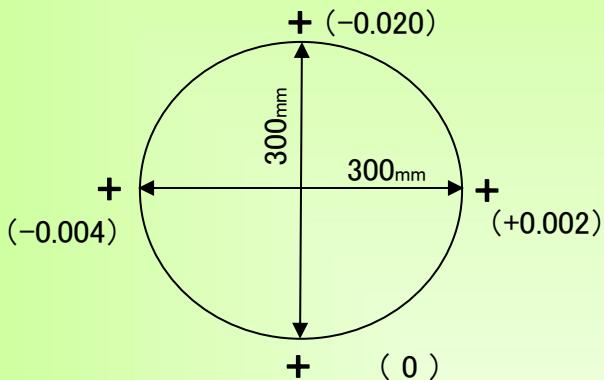


主軸振れ

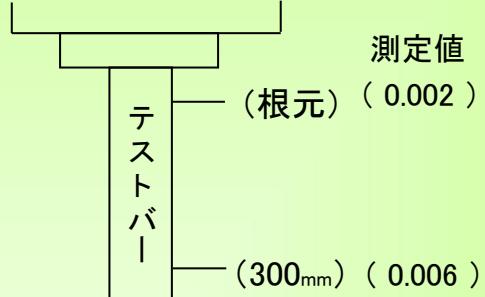


直角度


【YZ】測定値 (0.014)

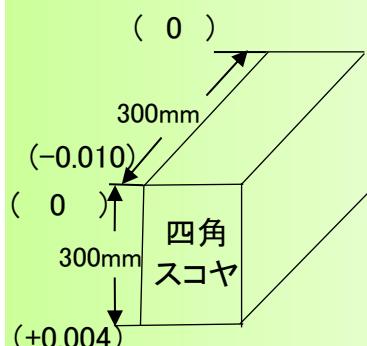

【XZ】測定値 (0.020)

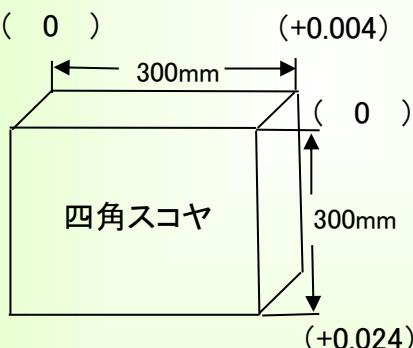


【XY】測定値 (0.002)

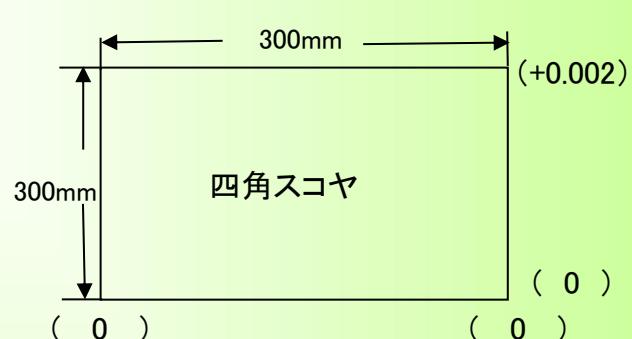

上面精度

※テーブルサイズ 1100×600

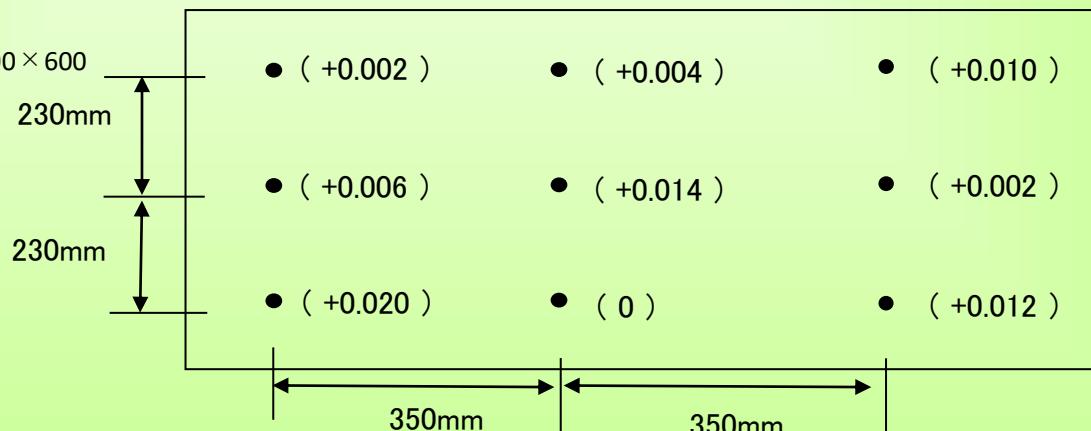

2025/8/1