


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2006.12	管理番号	P009121
型式	α-T21iEL	測定者	野辺沼	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

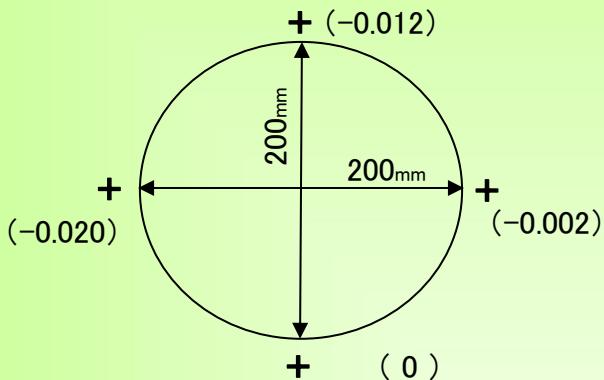


主軸振れ

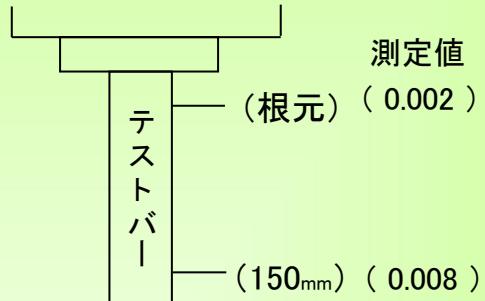


直角度

【YZ】測定値 (0.008)

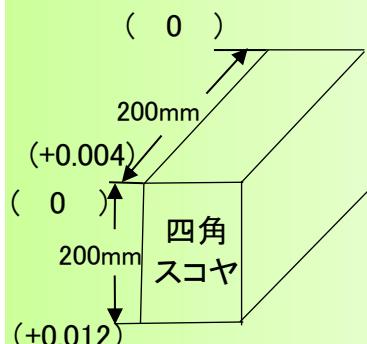

【XZ】測定値 (0.016)

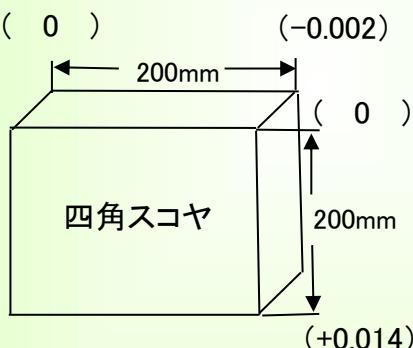


【XY】測定値 (0.004)



上面精度

※テーブルサイズ 850×410

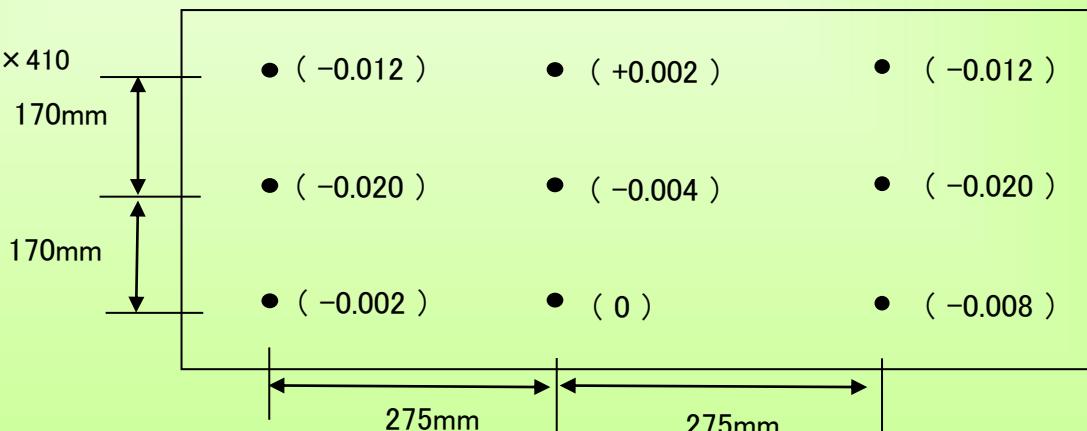

2026/1/29