


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2006	管理番号	P009166
型式	NV5000 α 1A/40	測定者	野辺沼	アシスタント	長谷川

振り回し(300ピッチ)

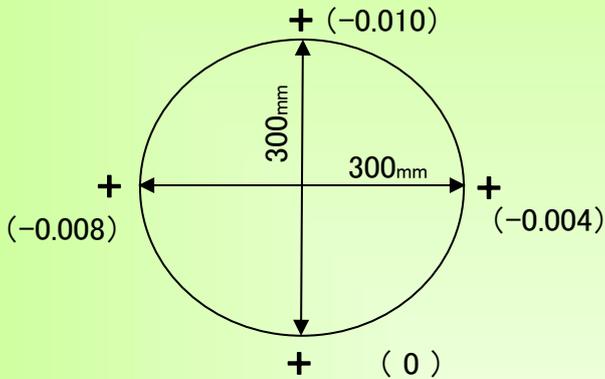

主軸振れ



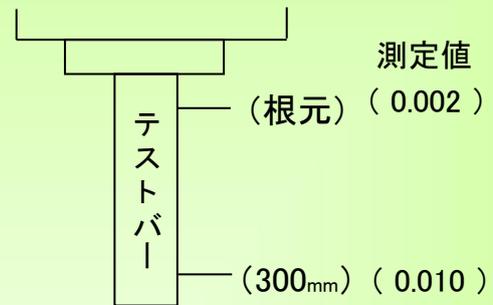


直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.004)

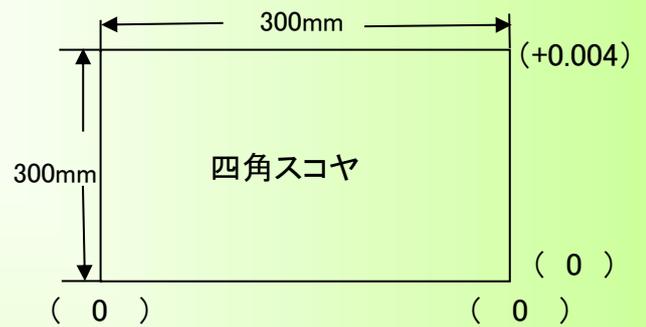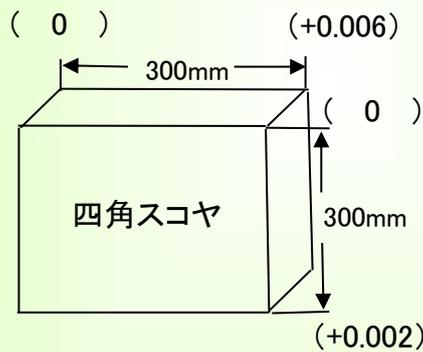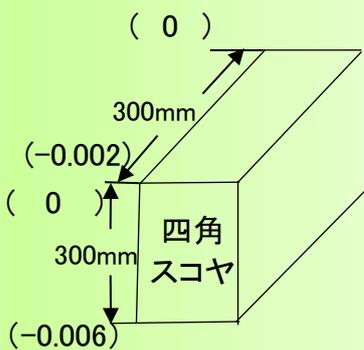

上面精度

※テーブルサイズ 1100×600

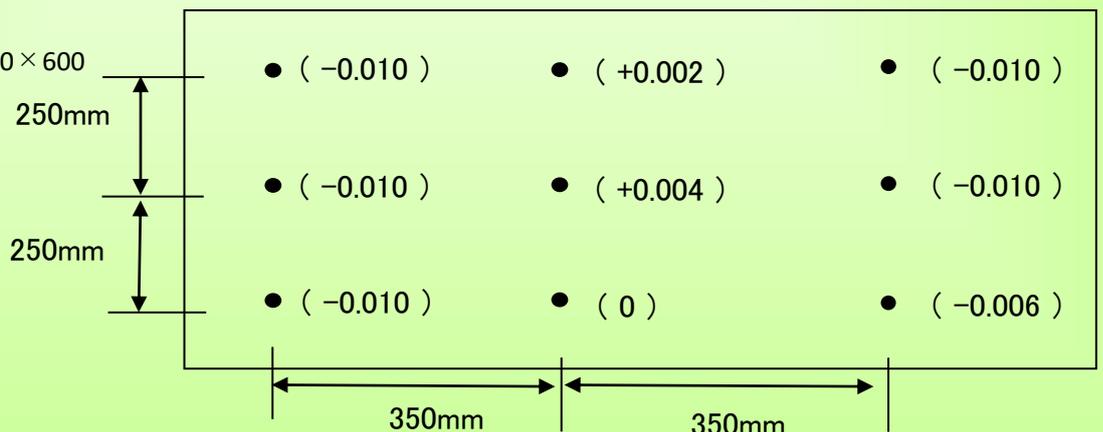

2026/2/16