


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	2005	管理番号	P009094
型式	V56	測定者	立川	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

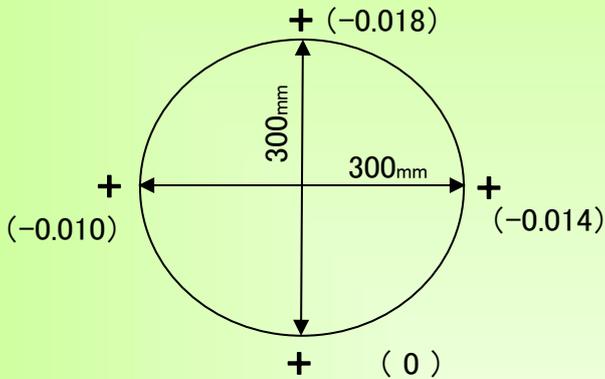

## 主軸振れ


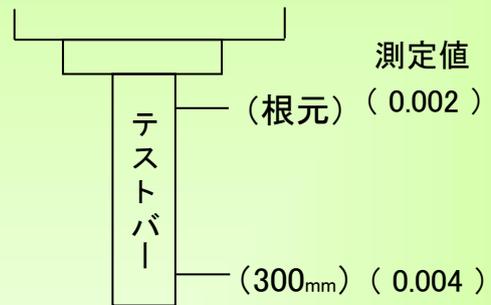


## 直角度

【YZ】測定値 (0.002)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.002)

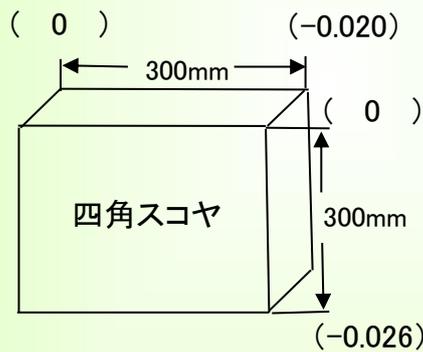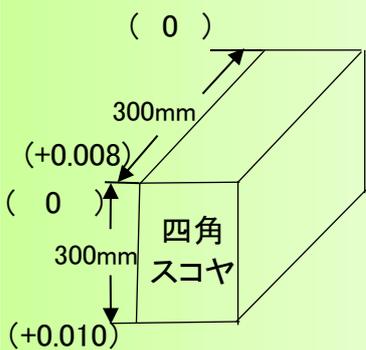

## 上面精度

※テーブルサイズ 1050×550

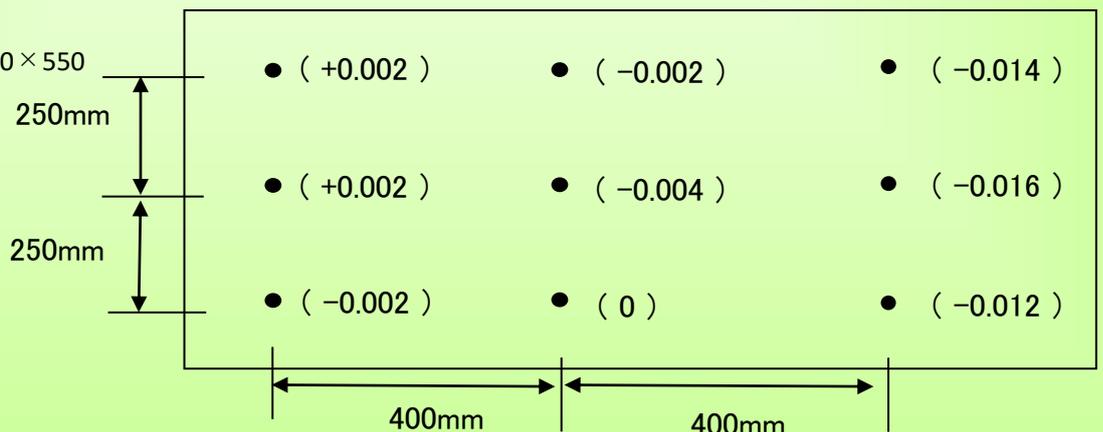

2026/2/6