


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2006	管理番号	P009160
型式	α -T14iEE	測定者	平沢	アシスタント	関根

振り回し(200ピッチ)

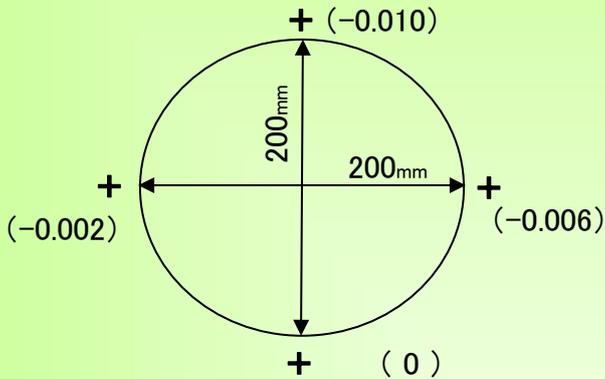

主軸振れ



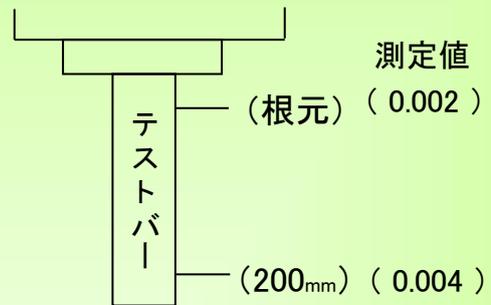


直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.008)

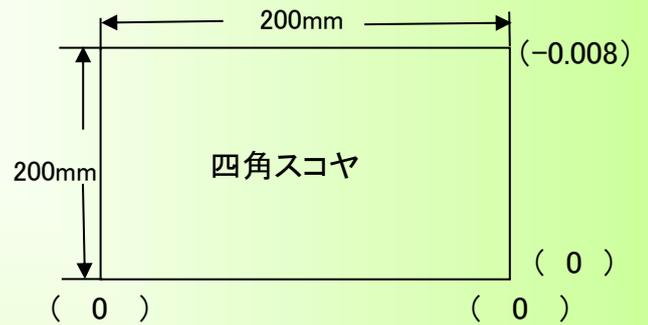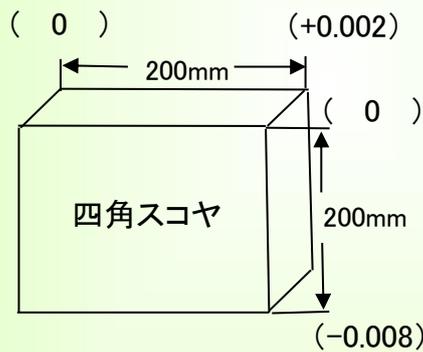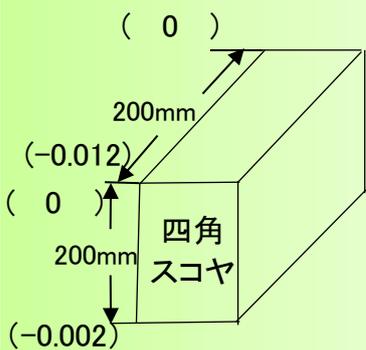

上面精度

※テーブルサイズ 650×400

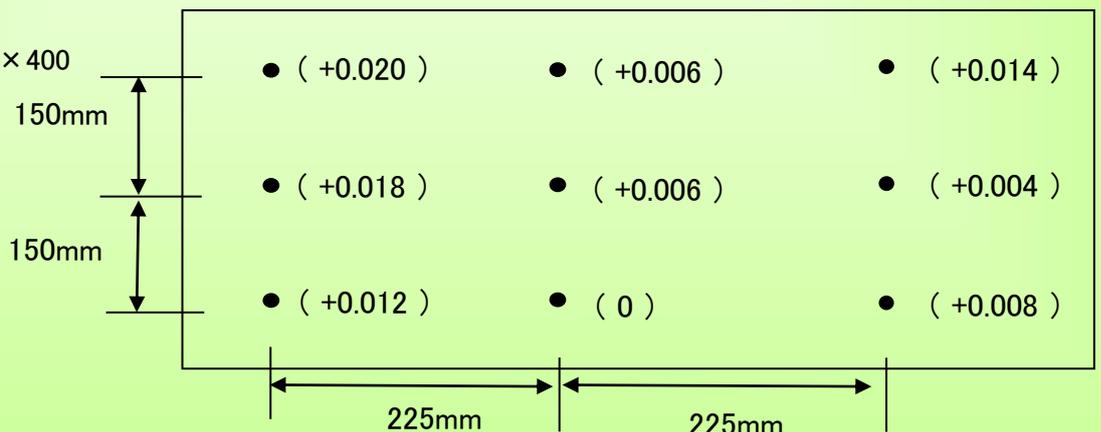

2026/2/16