


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2007	管理番号	P009162
型式	$\alpha$ -T14iEE	測定者	平沢	アシスタント	関根

## 振り回し(200ピッチ)

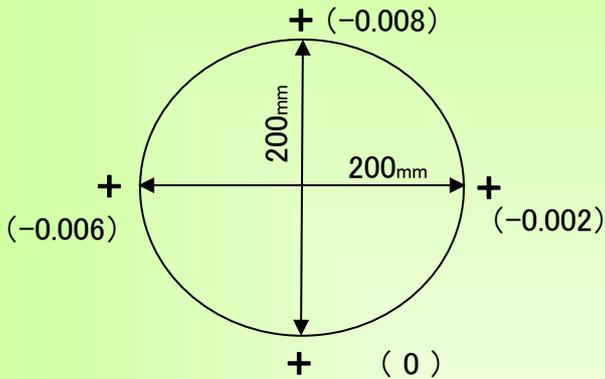

## 主軸振れ



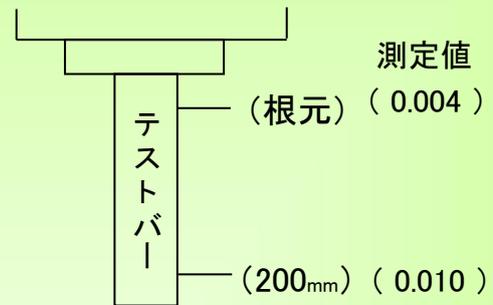


## 直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.012)

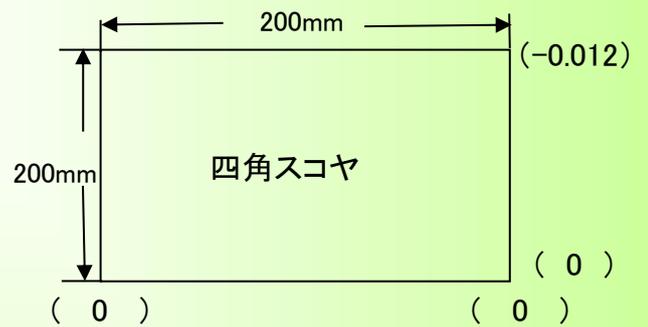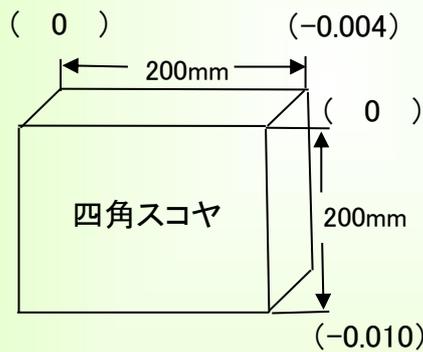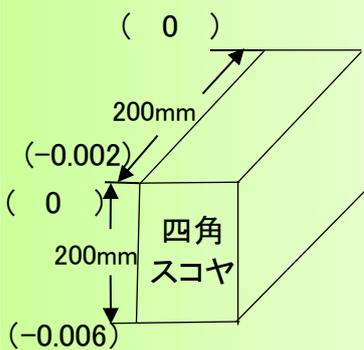

## 上面精度

※テーブルサイズ 650×400

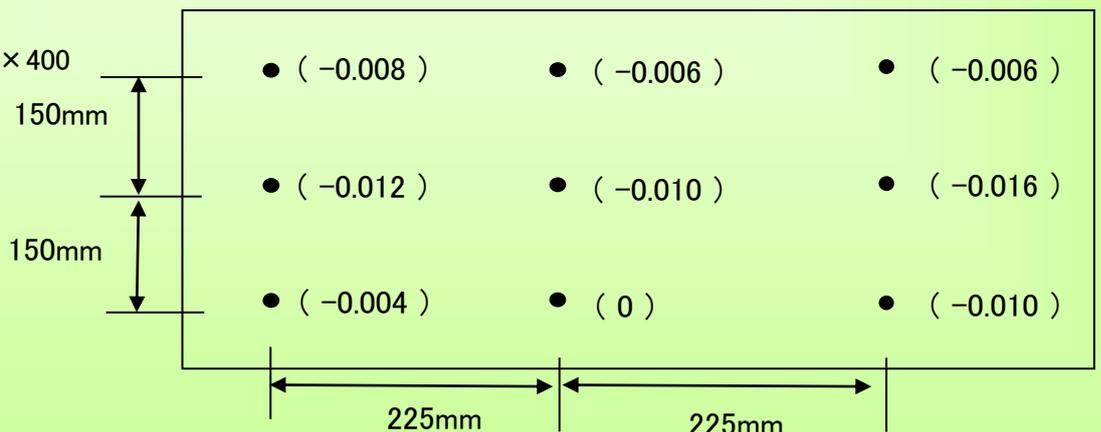

2026/2/16