


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2011	管理番号	P009073
型式	α -T21iFLa	測定者	近藤	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

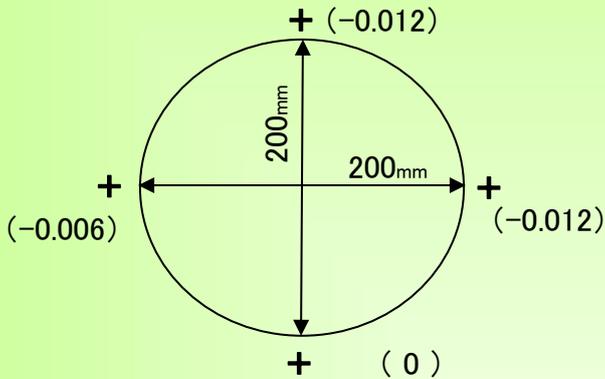

主軸振れ


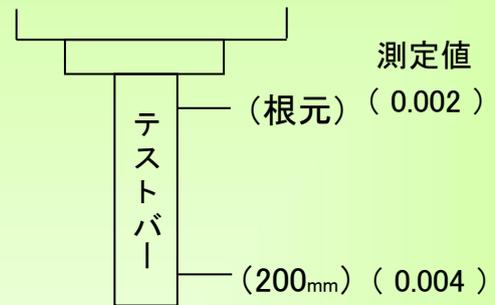


直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.016)

【XY】測定値 (0.008)

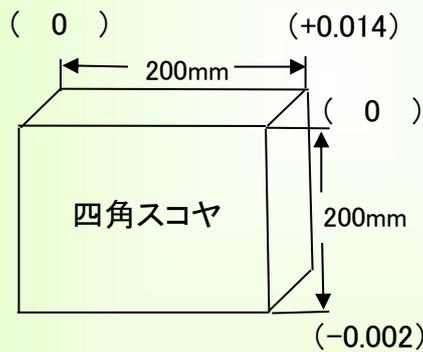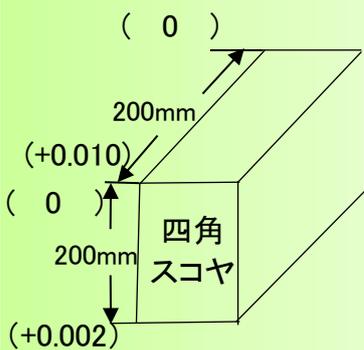

上面精度

※テーブルサイズ 850×410

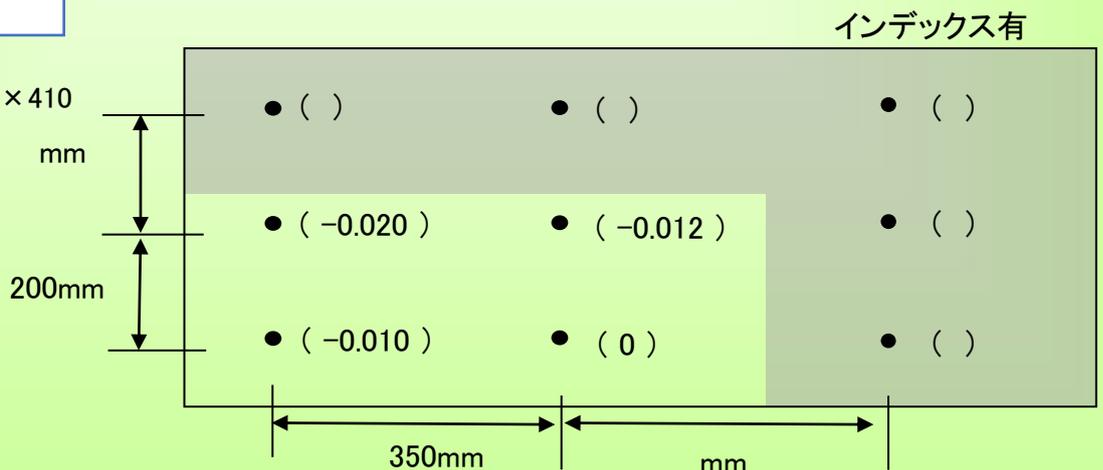

2026/3/5