


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	メクトロン	年式	2011.10	管理番号	P008762
型式	MTV-T351W	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

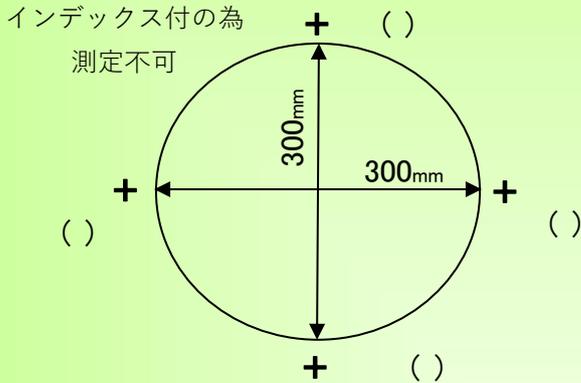

主軸振れ

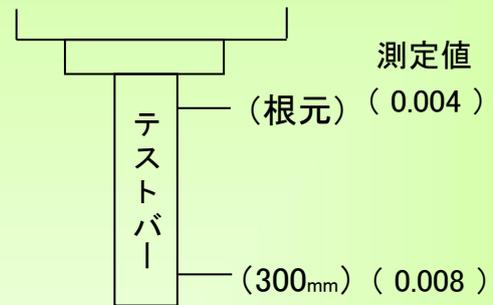




直角度

【YZ】測定値 (0.034)

【XZ】測定値 (0.028)


【XY】測定値 ()

インデックス付の為測定不可

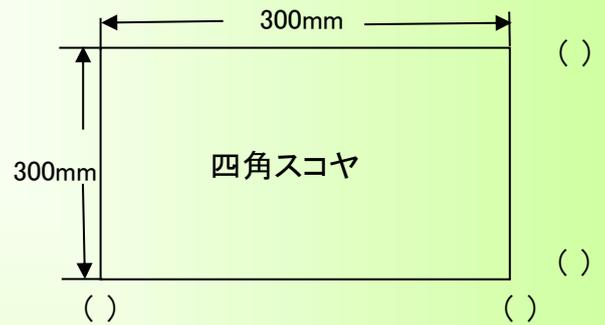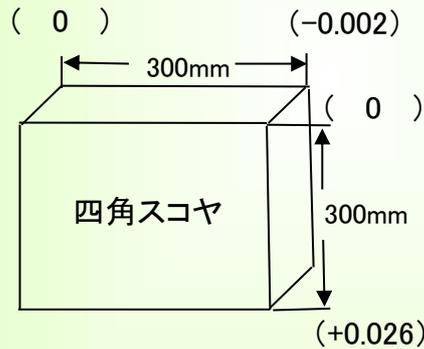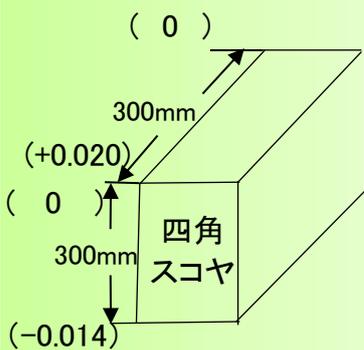

上面精度

※テーブルサイズ 610×380

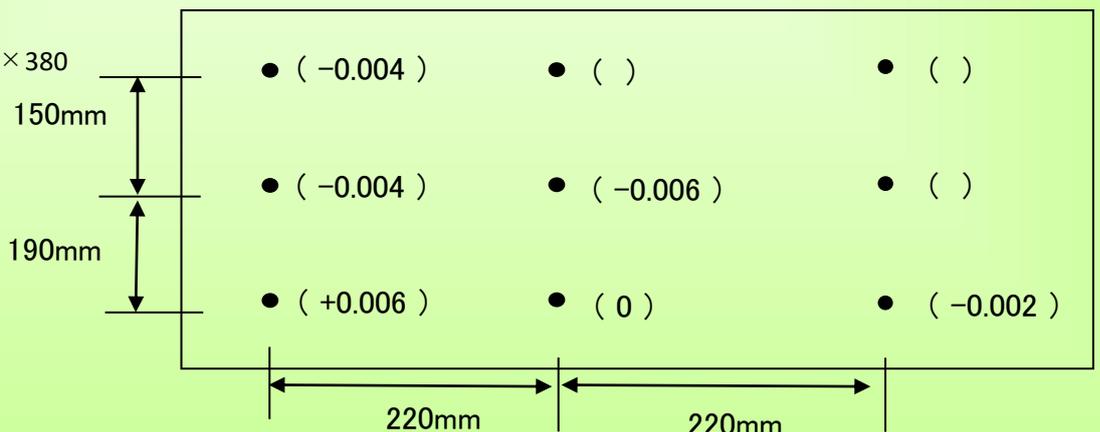

2026/3/7