


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2015	管理番号	P009194
型式	MB-46VAE	測定者	平沢	アシスタント	関根

振り回し(300ピッチ)

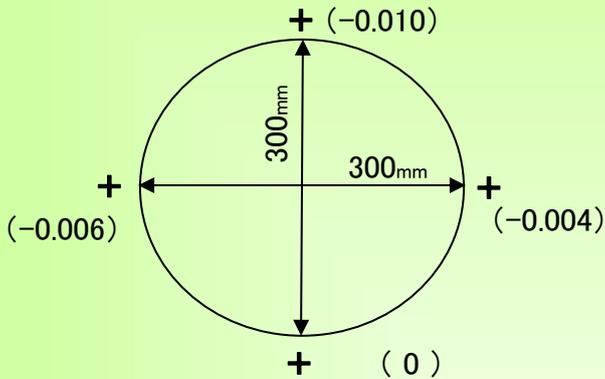

主軸振れ



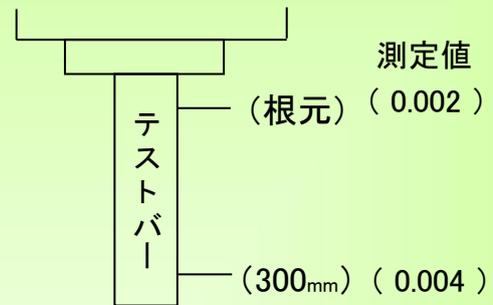


直角度

【YZ】測定値 (0.012)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.002)

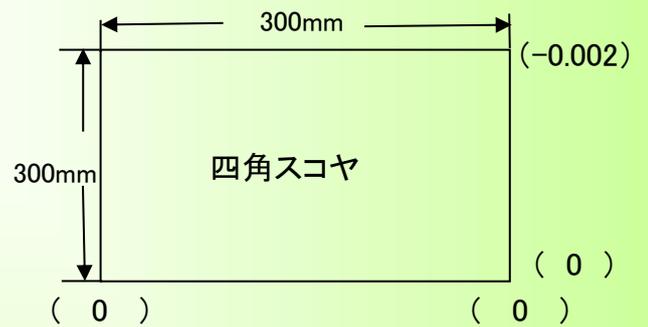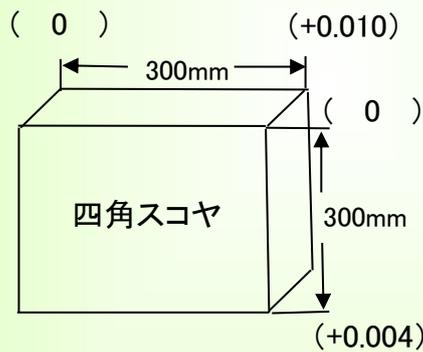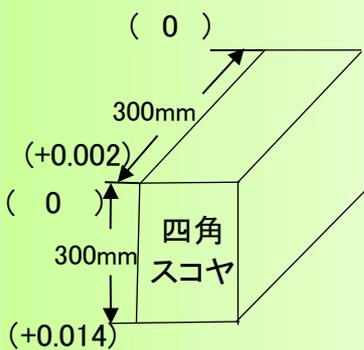

上面精度

※テーブルサイズ 1000×460

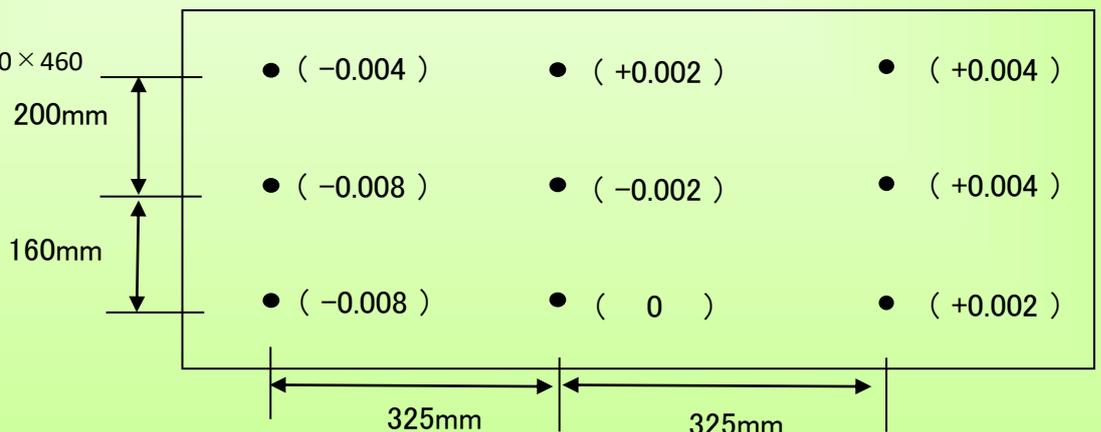

2026/3/18