


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ツガミ	年式	2023	管理番号	P009165
型式	VA4G	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

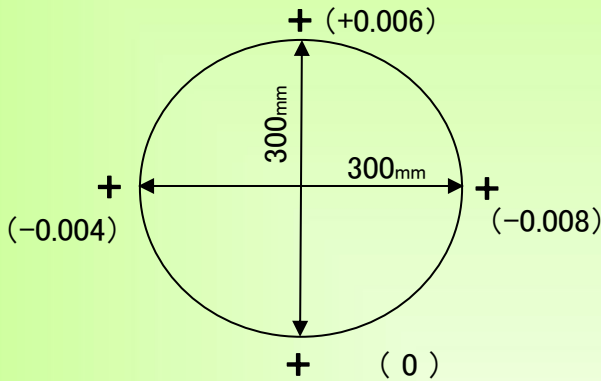

## 主軸振れ



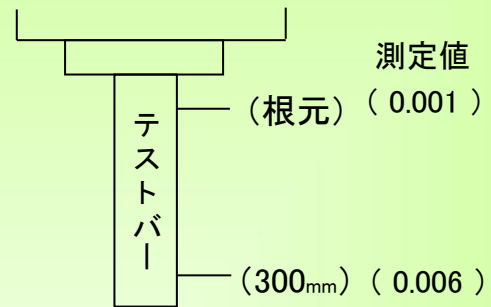


## 直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.002)

【XY】測定値 (0.004)

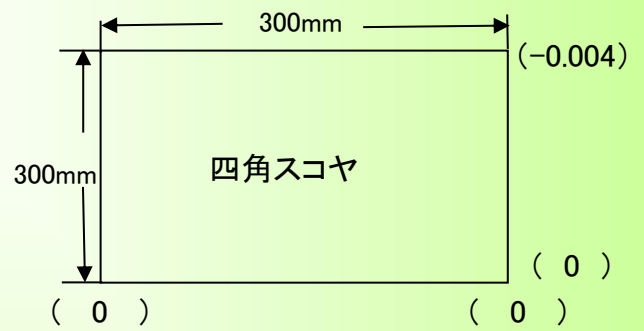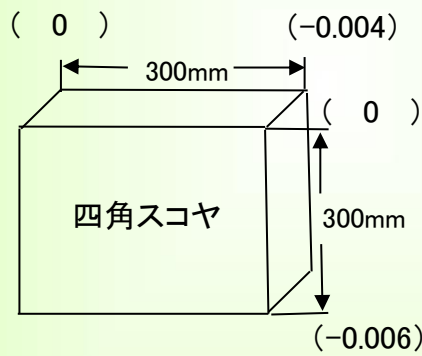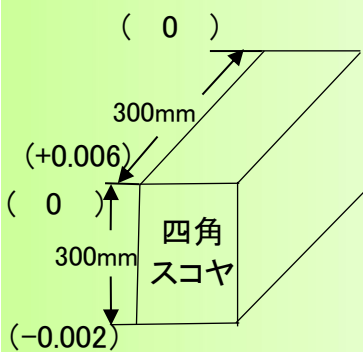

## 上面精度

※テーブルサイズ 850×510

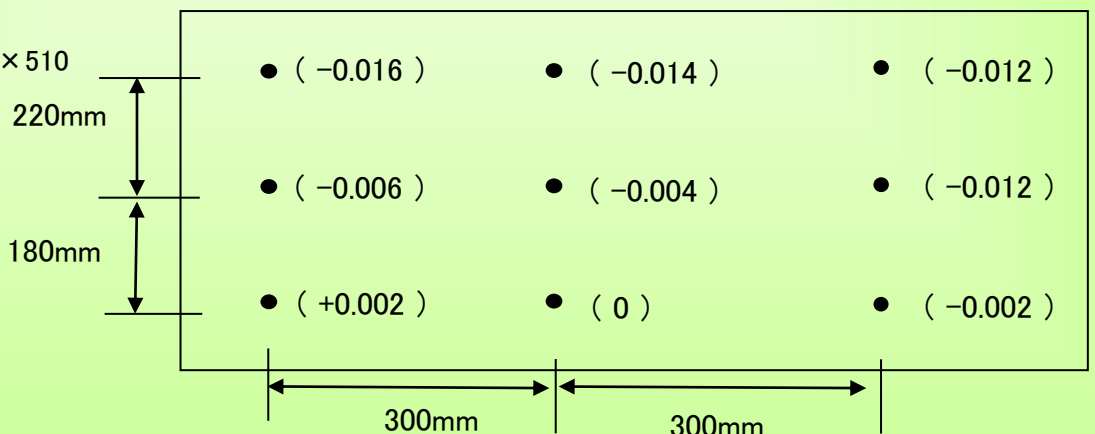

2026/3/27