


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	キタムラ機械	年式	2013	管理番号	P009060
型式	Mycenter3XG	測定者	立川	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

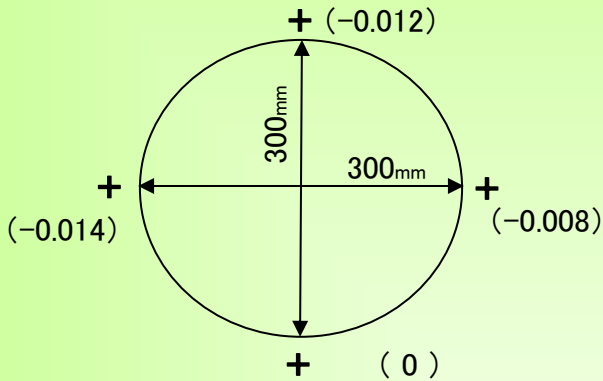

## 主軸振れ



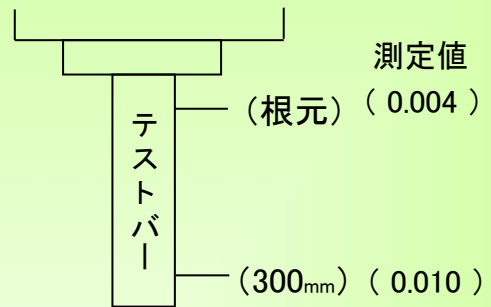


## 直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.002)

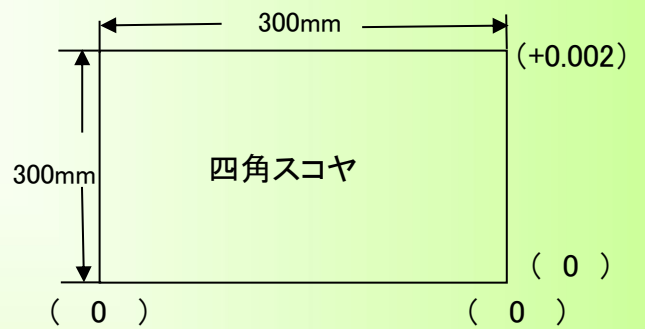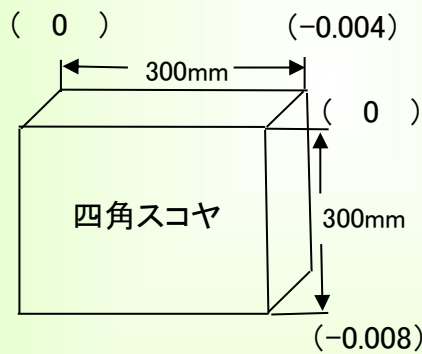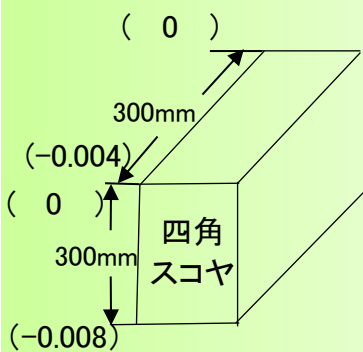

## 上面精度

※テーブルサイズ 900×410

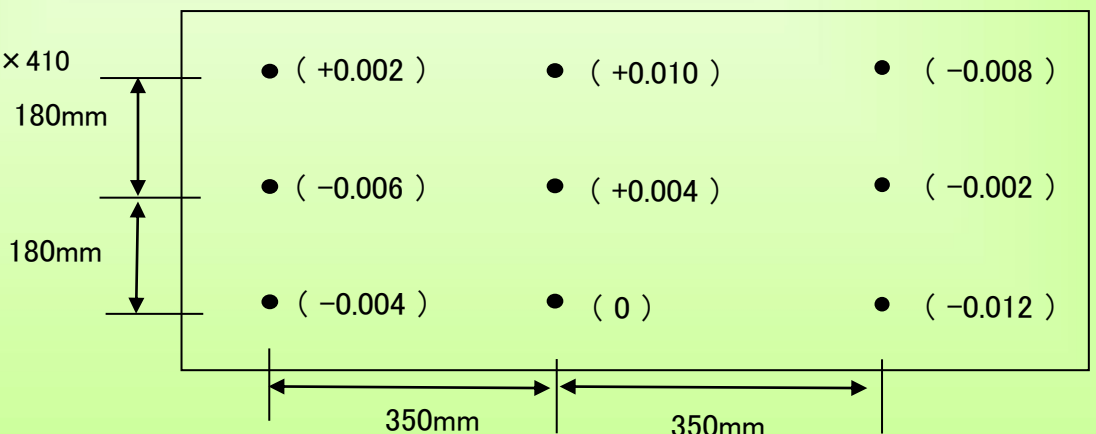

2026/4/3