精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2004	管理番号	P008733
型式	NH4000DCG	測定者	金子	アシスタント	

Z軸方向の平行度

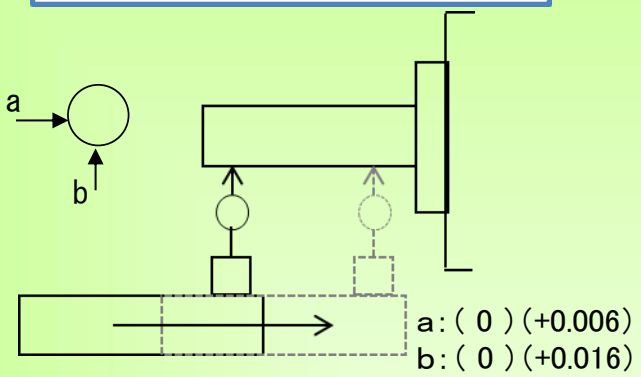

主軸振れ

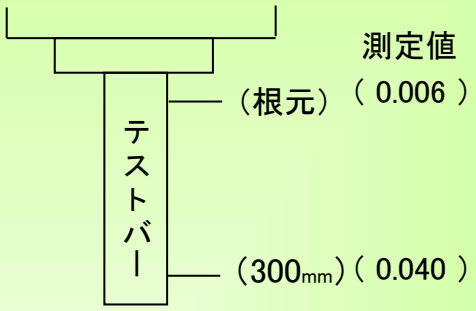

クランプ力　11.4kN

直角度

【XY】測定値　(0.002)

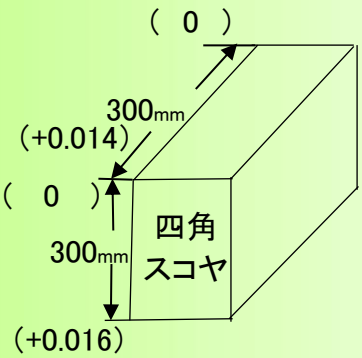

【ZY】測定値　(0.004)

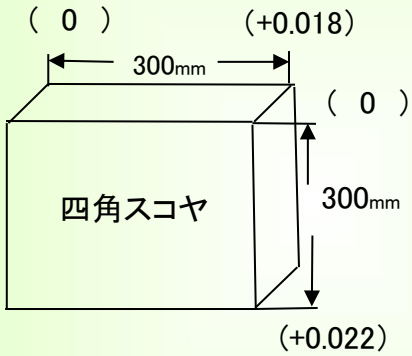

【ZX】測定値 (0.002)

上面精度

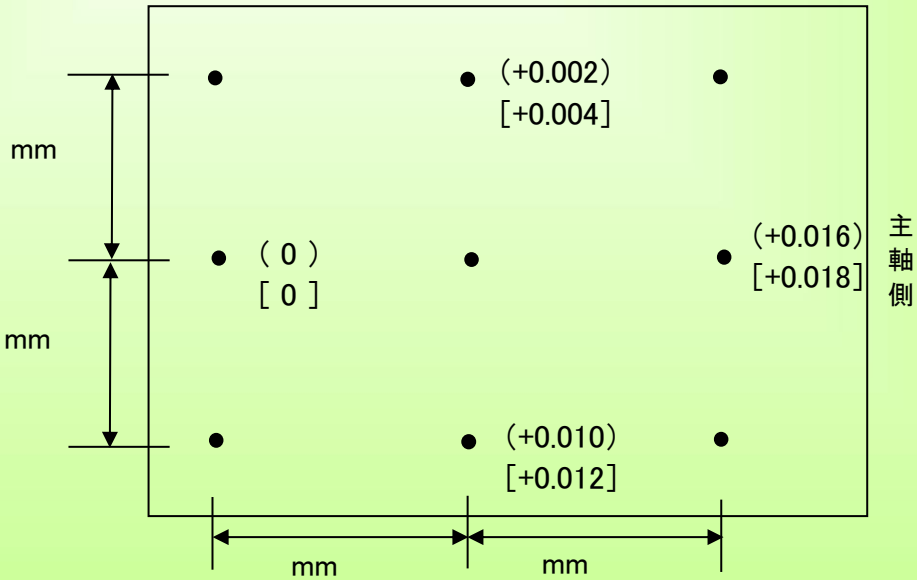

テーブルサイズ：角
(　　)パレット1
[　　]パレット2

2026/4/10