


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2005	管理番号	P009123
型式	VM5III	測定者	近藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

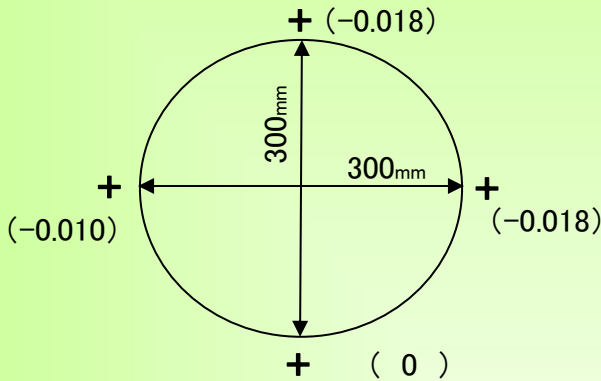

主軸振れ



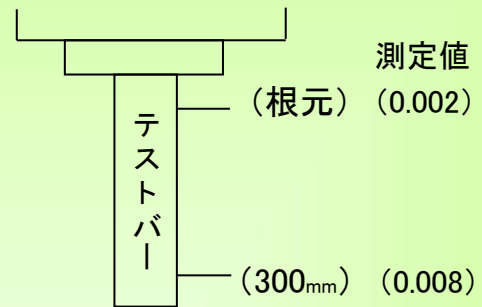


直角度

【YZ】測定値 (0.012)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.010)

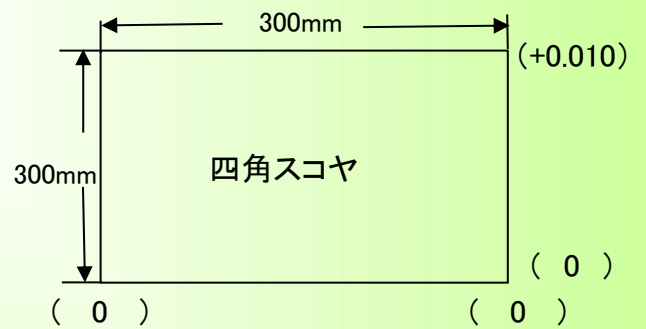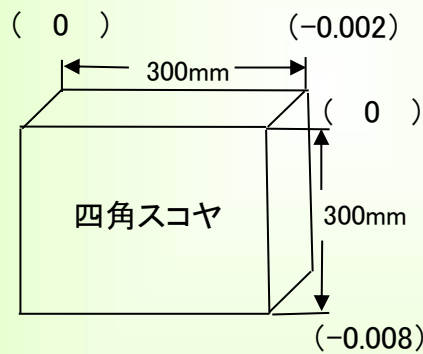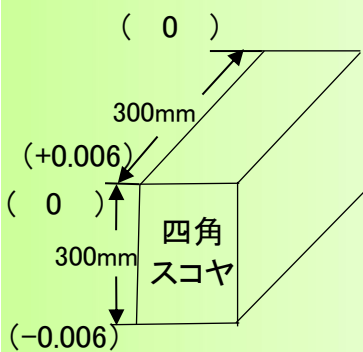

上面精度

※テーブルサイズ 1250×560

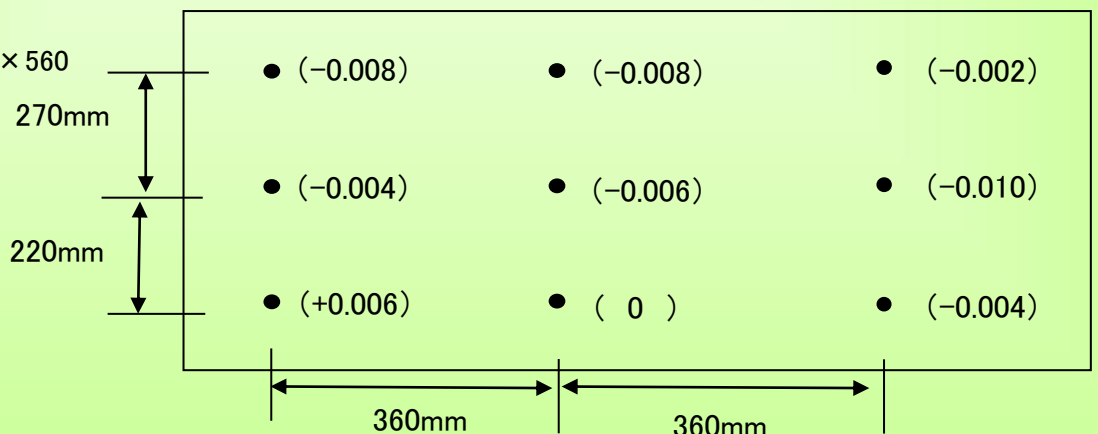

2026/4/3