


精度測定検査表


Examination for precision list

| | | | | | |
|------|----------|-----|---------|--------|---------|
| メーカー | オークマ | 年式 | 2007.10 | 管理番号 | P009048 |
| 型式 | MA-550VB | 測定者 | 金子 | アシスタント | |

振り回し(300ピッチ)

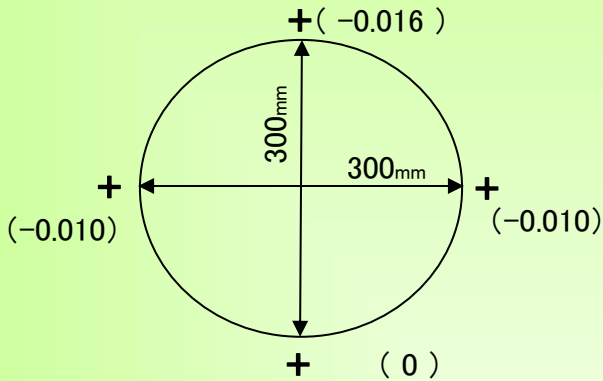

主軸振れ



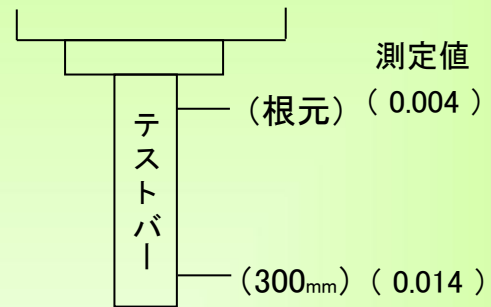


直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.004)

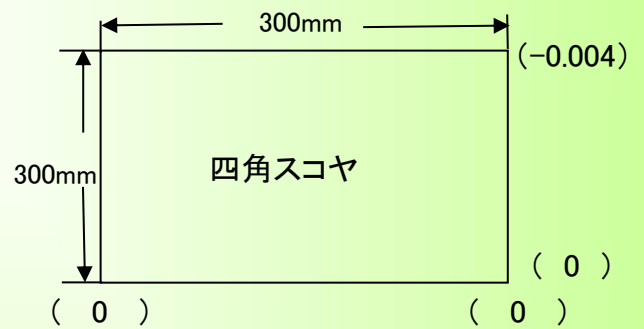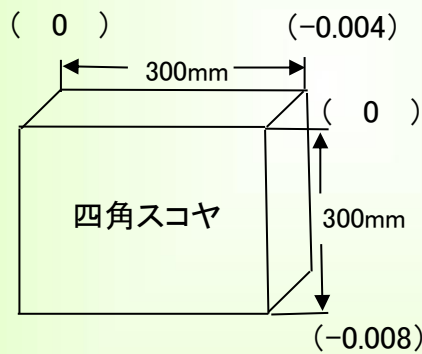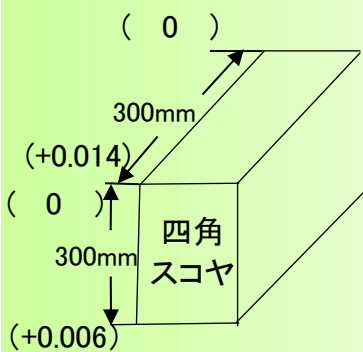

上面精度

※テーブルサイズ 1300×560

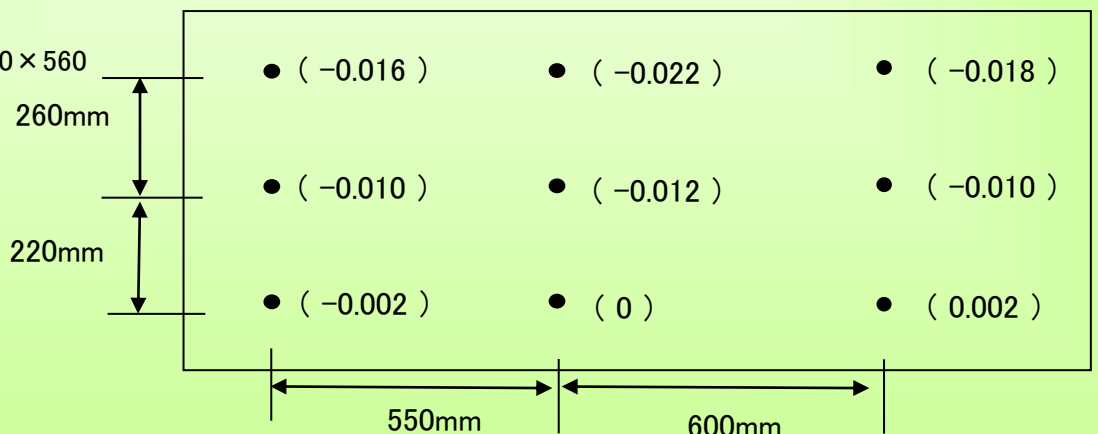

2026/4/20