


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	大隈豊和	年式	2000	管理番号	P009237
型式	MILLAC-550H	測定者	金子	アシスタント	

## Z軸方向の平行度

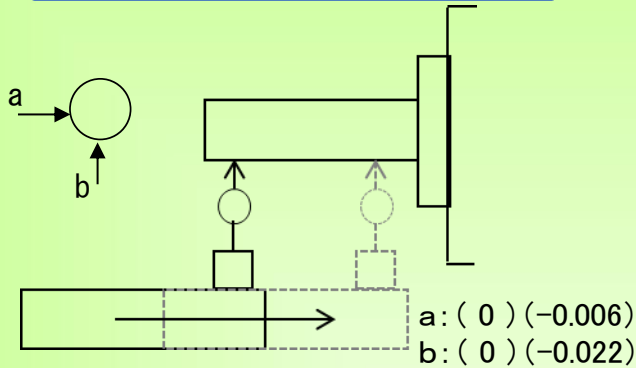

## 主軸振れ

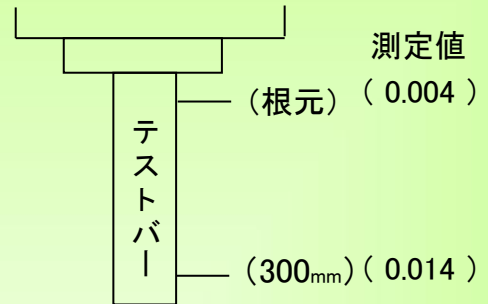




クランプ力 11.4kN

## 直角度

【XY】測定値 (0.014)


【ZY】測定値 (0.026)

【ZX】測定値 (0.008)

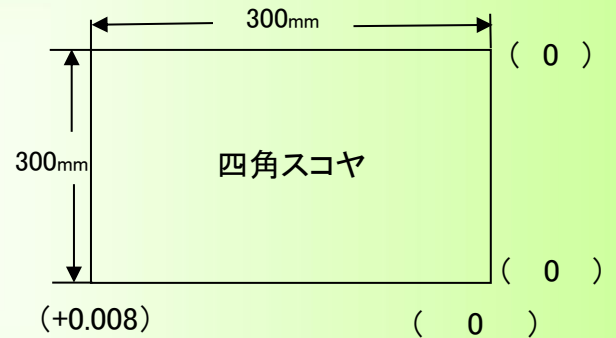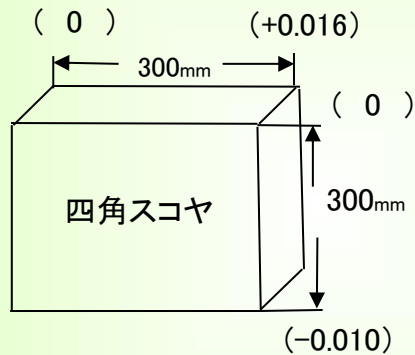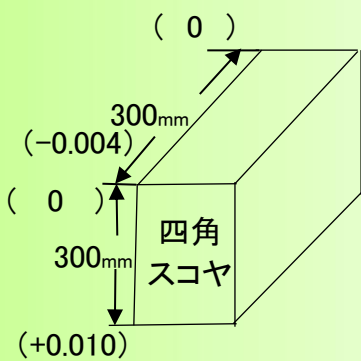

## 上面精度

テーブルサイズ: 550角  
( )パレット1  
[ ]パレット2

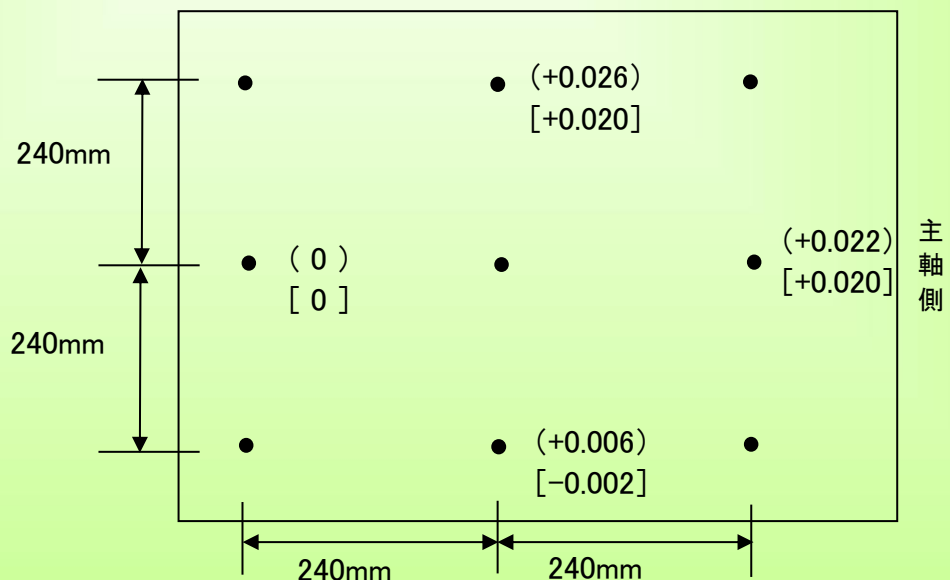

2026/4/24