


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ブラザー	年式	2019	管理番号	P009240
型式	S500X2	測定者	野辺沼	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

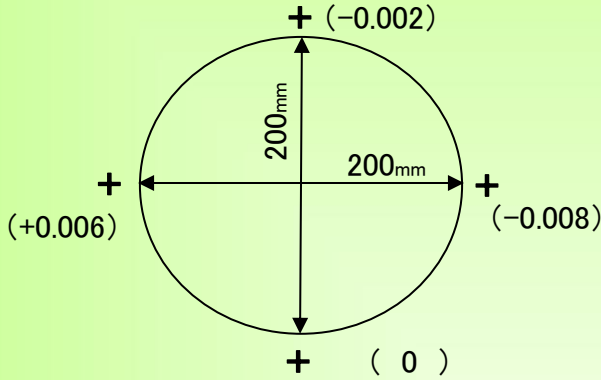

主軸振れ



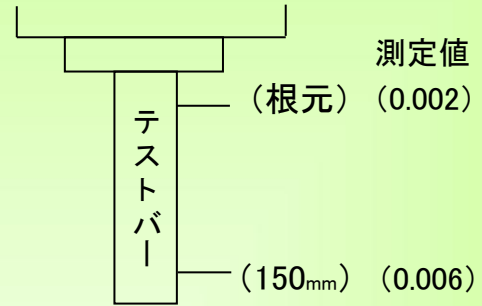


直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.010)

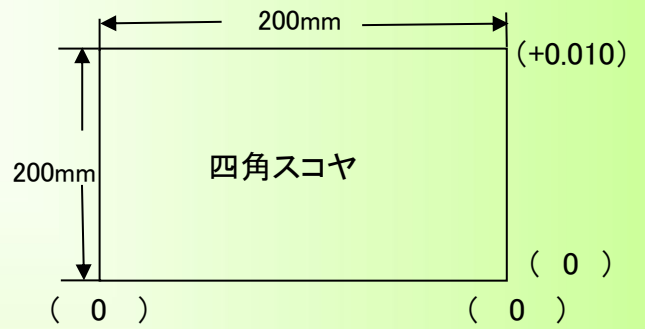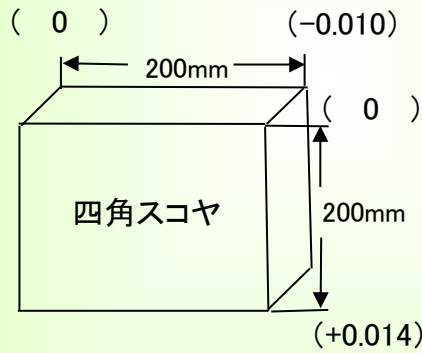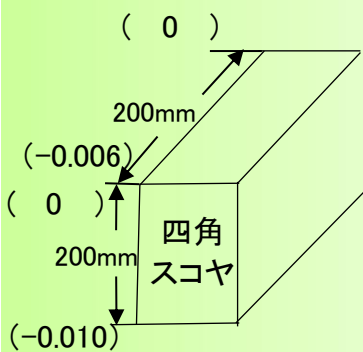

上面精度

※テーブルサイズ 530×330

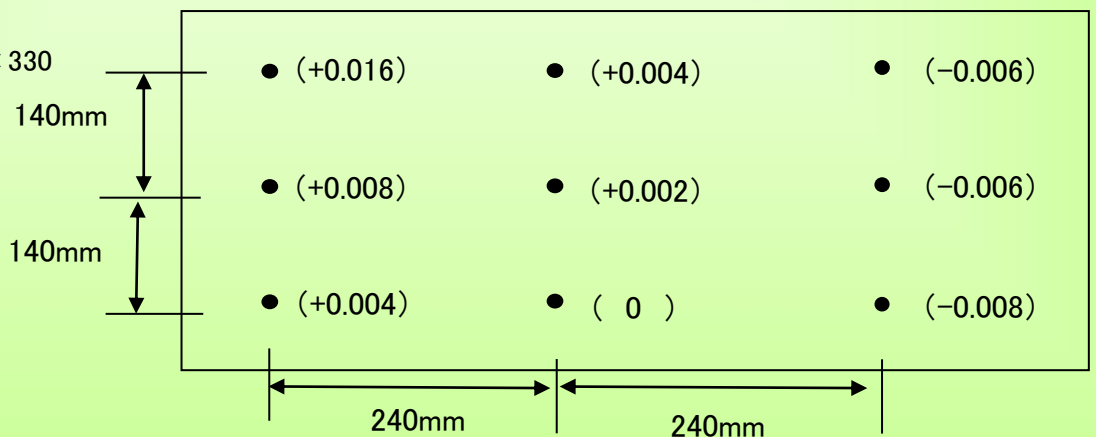

2026/4/27