


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2019	管理番号	P009167
型式	α -D21MiB5	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

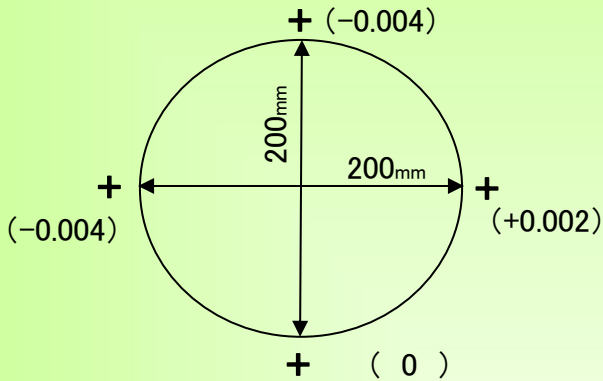

主軸振れ



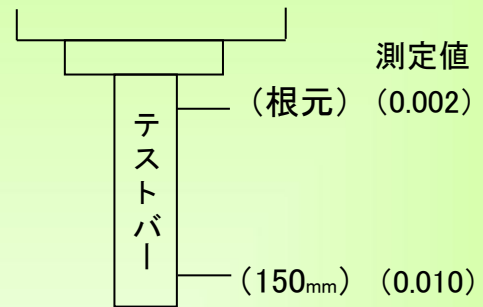


直角度

【YZ】測定値 (0.006)

【XZ】測定値 (0.006)


【XY】測定値 (0.004)

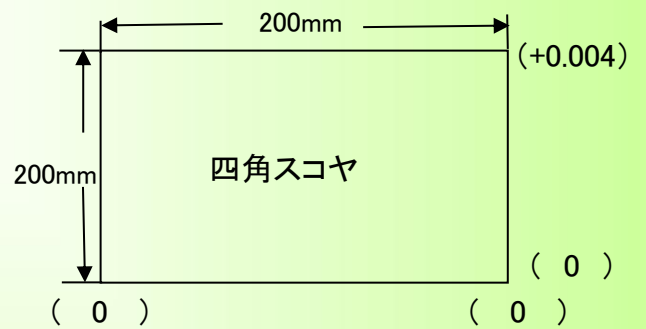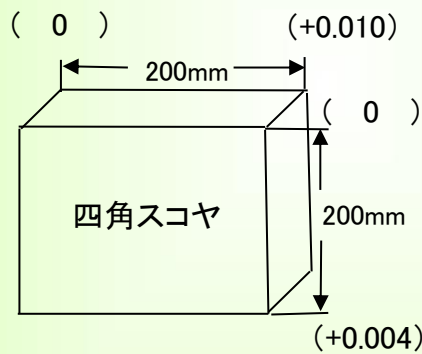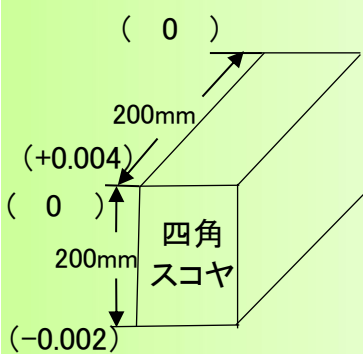

上面精度

※インデックス

※テーブルサイズ 650×400

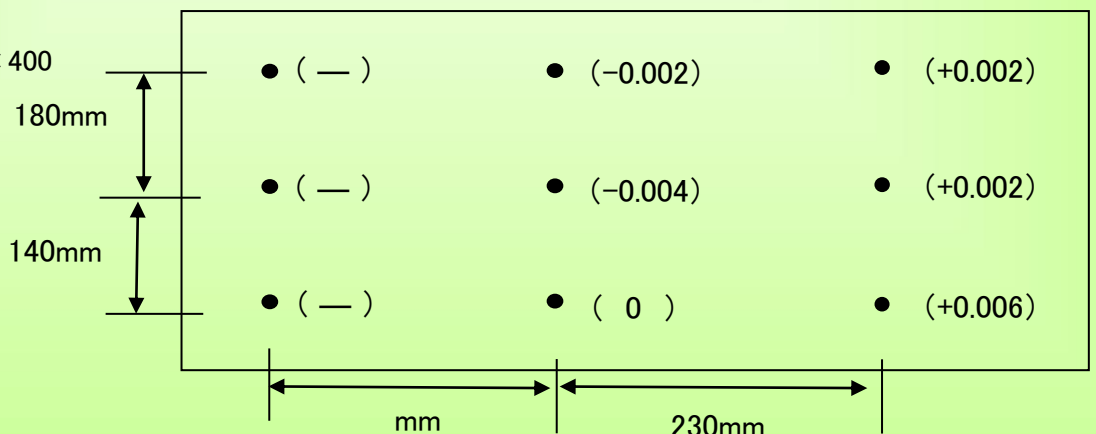

2026/3/10