


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2006	管理番号	P009224
型式	MB-46VA	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

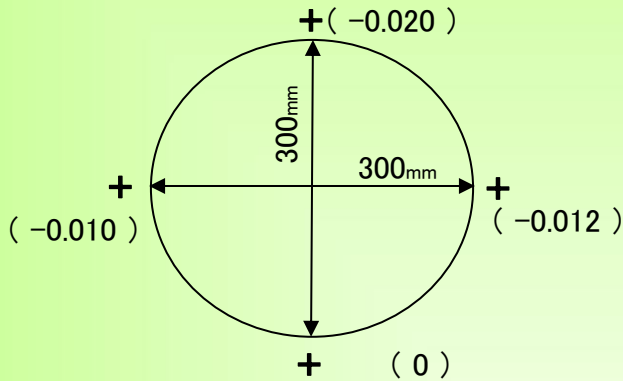

主軸振れ

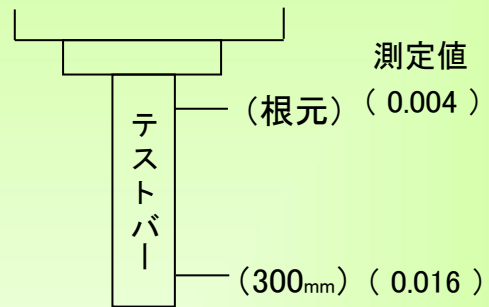




※クランプ力8.93kN

直角度

【YZ】測定値 (0.026)


【XZ】測定値 (0.028)

【XY】測定値 (0.002)

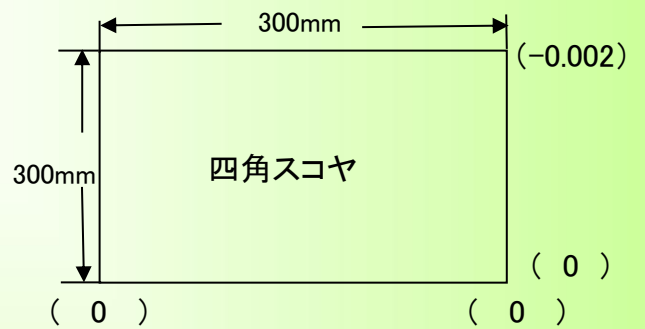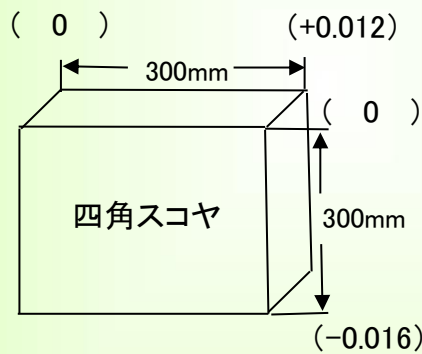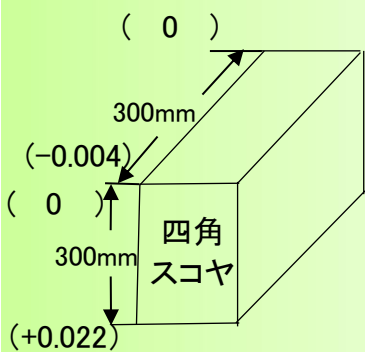

上面精度

※テーブルサイズ 760×460

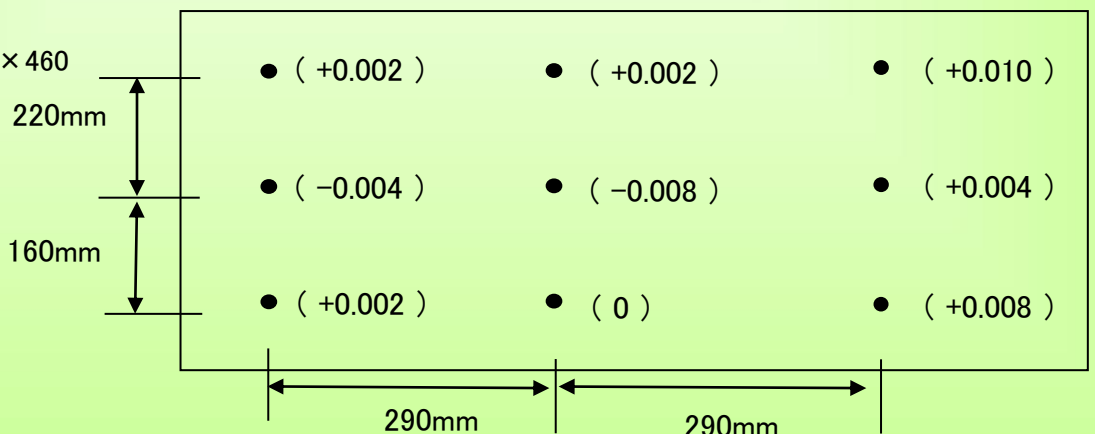

2026/4/27