


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2007	管理番号	P009175
型式	VM5III	測定者	野辺沼	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

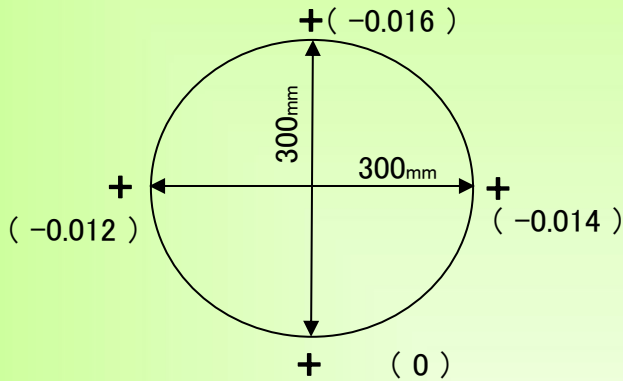

## 主軸振れ

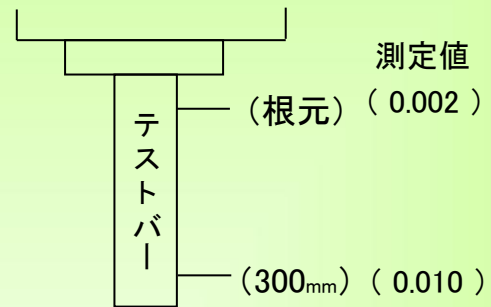




※クランプ力8.93kN

## 直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.004)

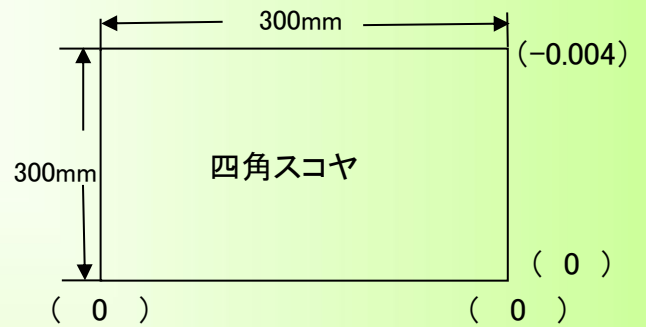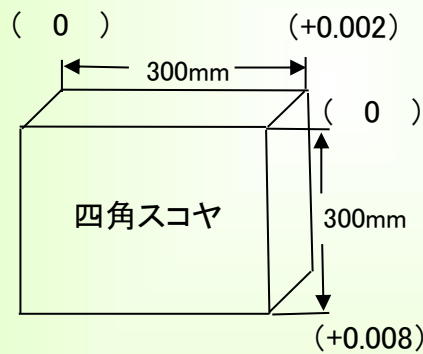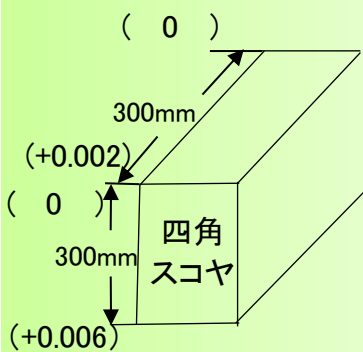

## 上面精度

※テーブルサイズ 1050×560

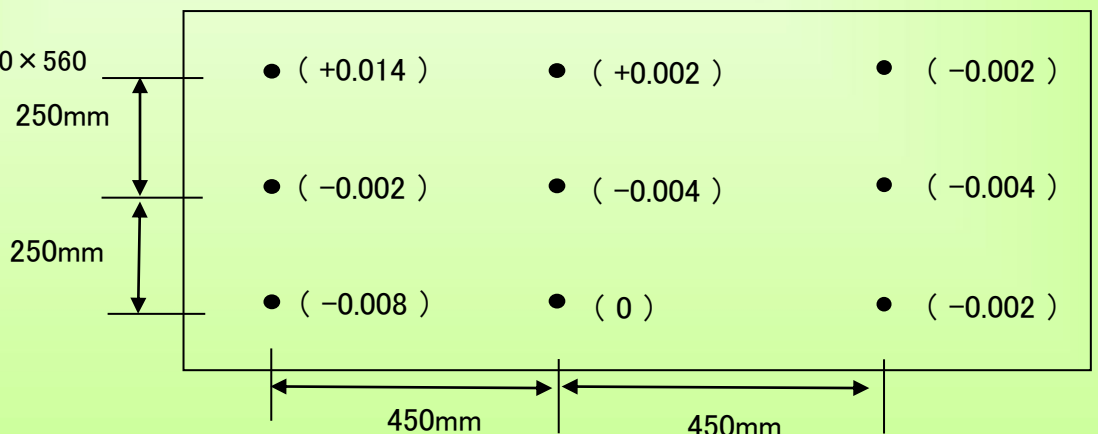

2026/4/27