


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2016	管理番号	H019884
型式	MU-5000V-L	測定者	仙田	アシスタント	蔵内

振り回し(300ピッチ)

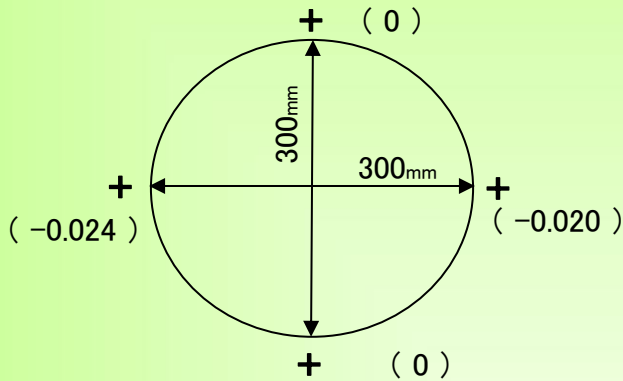

主軸振れ



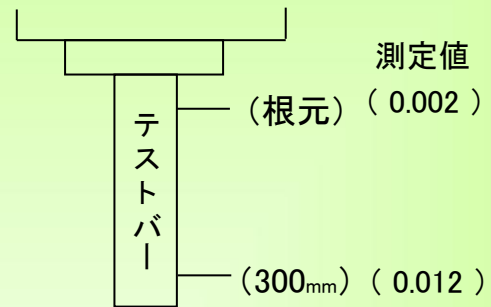


直角度

【YZ】測定値 (0.010)

【XZ】測定値 (0.022)

【XY】測定値 (0.018)

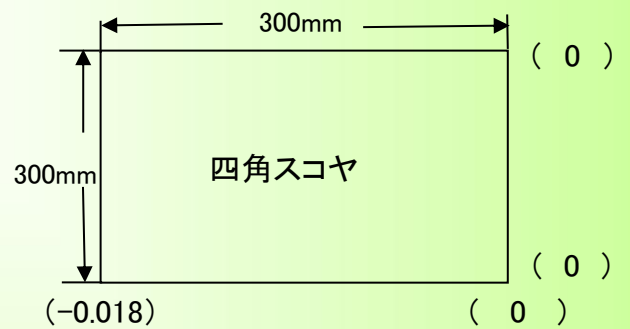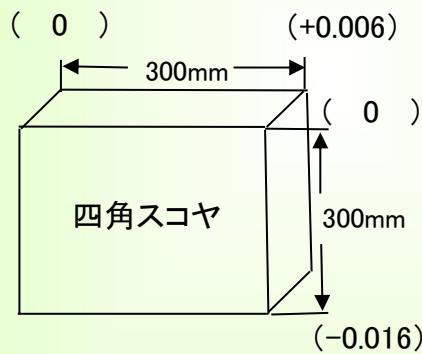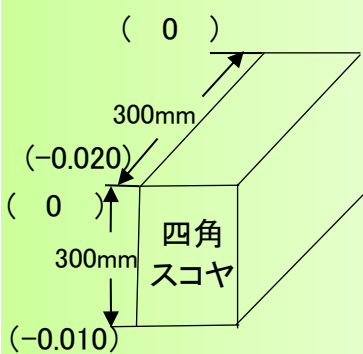

上面精度

※テーブルサイズ Φ500mm

