


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ブラザー	年式	2010	管理番号	P009204
型式	TC-R2A	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

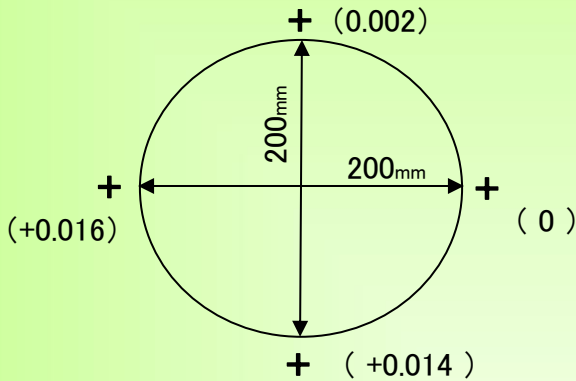

主軸振れ



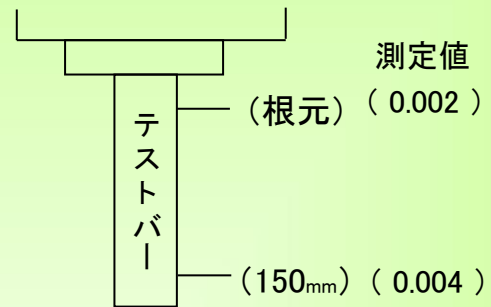


直角度

【YZ】測定値 (0.016)


【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.002)

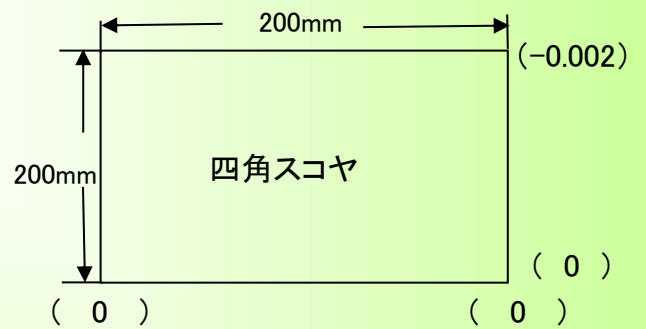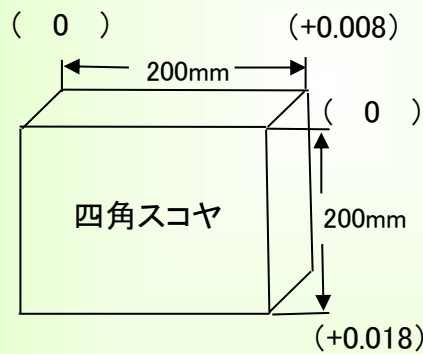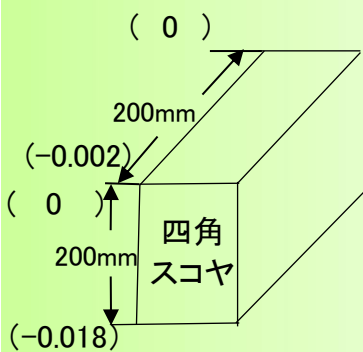

上面精度

※テーブルサイズ 500×300

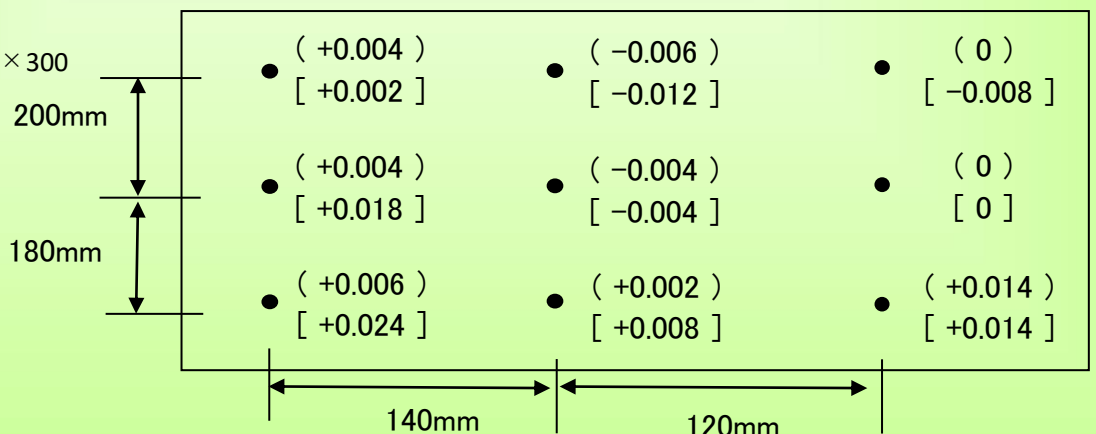

2026/5/25