


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2017	管理番号	P009164
型式	CMX800V	測定者	黒坂	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

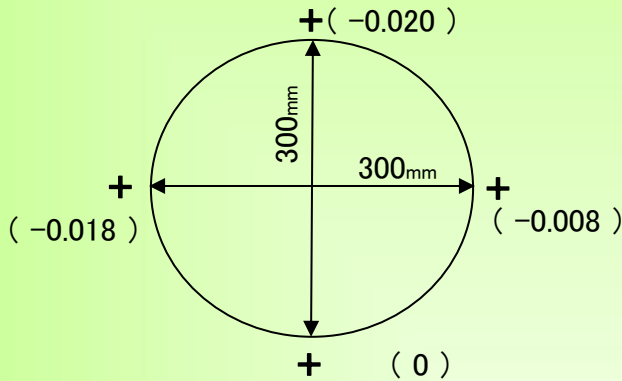

主軸振れ



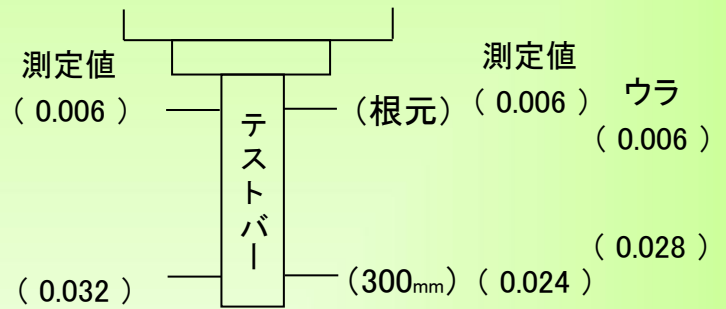


直角度

【YZ】測定値 (0.026)


【XZ】測定値 (0.002)

【XY】測定値 (0.004)

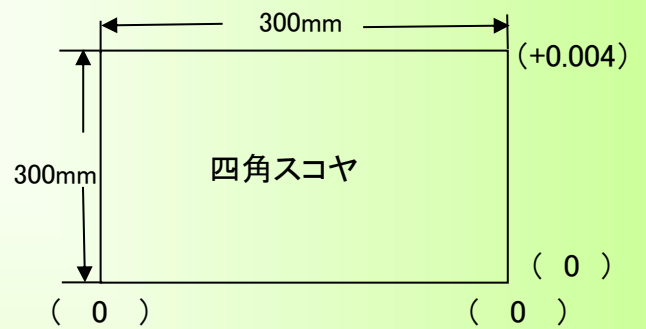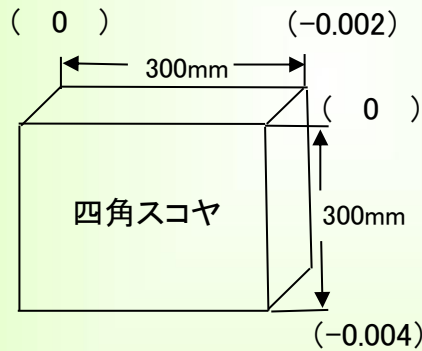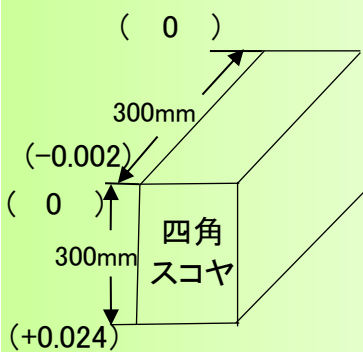

上面精度

※テーブルサイズ 1100×560

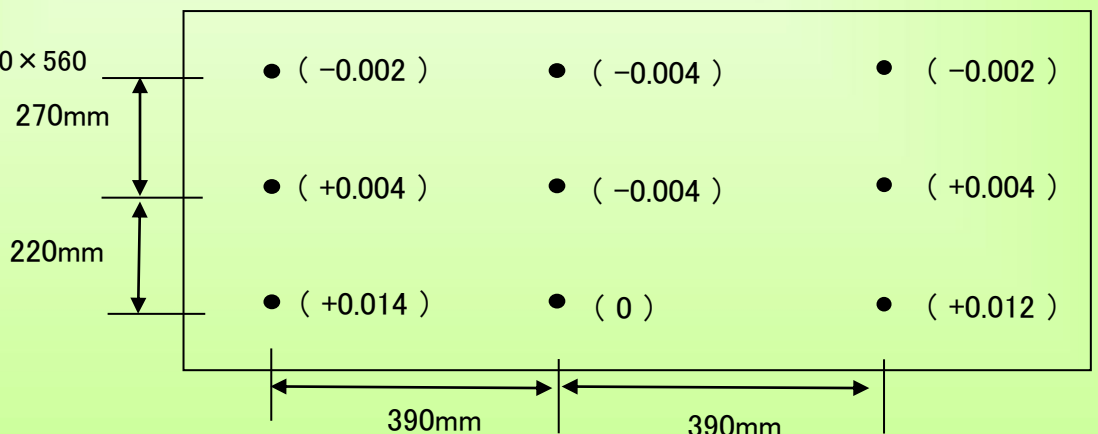

2026/5/18