


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2014.12	管理番号	P009235
型式	VM43R	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

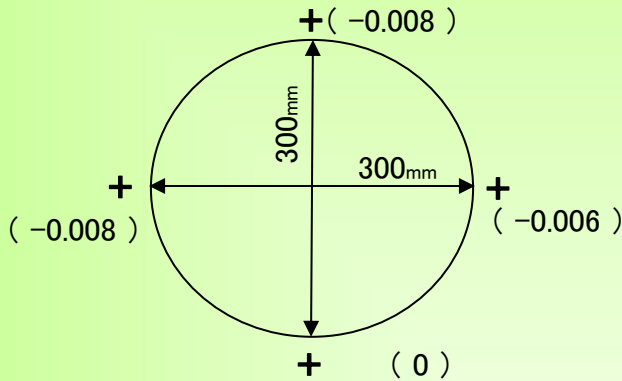

主軸振れ



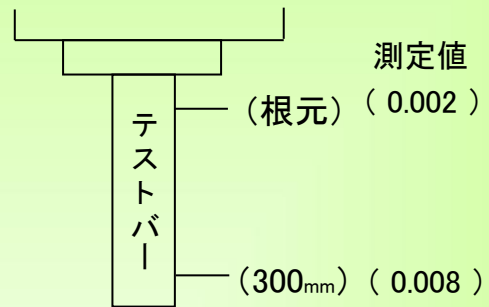


直角度

【YZ】 測定値 (-0.006)


【XZ】 測定値 (-0.006)

【XY】 測定値 (0.008)

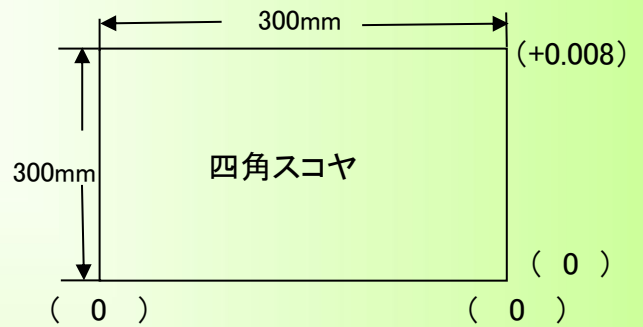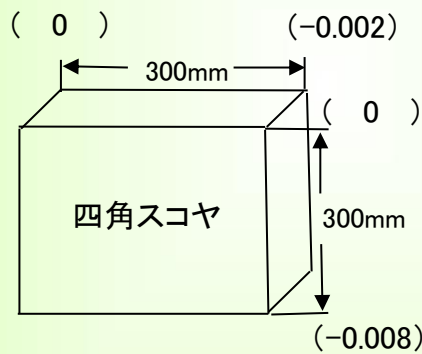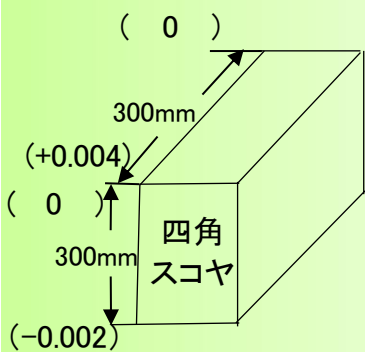

上面精度

※テーブルサイズ 800×420

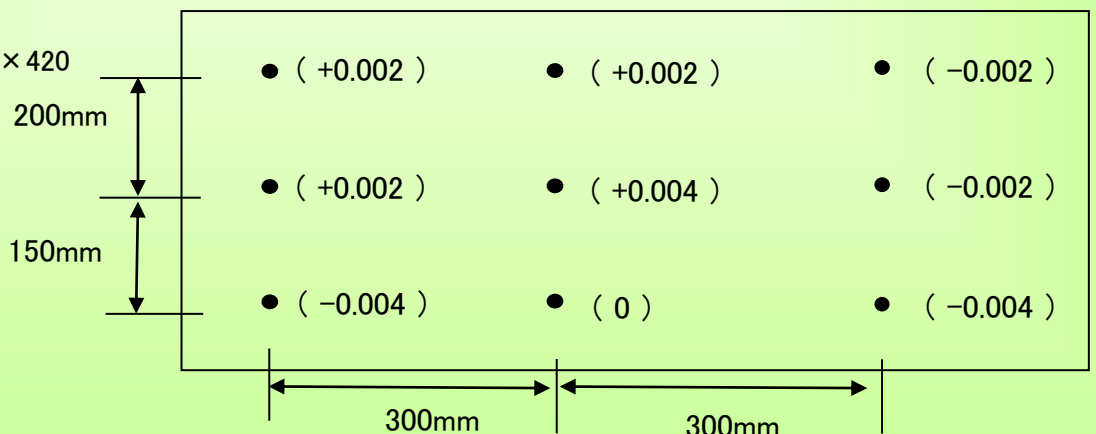

2026/4/22