


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2018	管理番号	P009273
型式	GENOS M460-VE	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

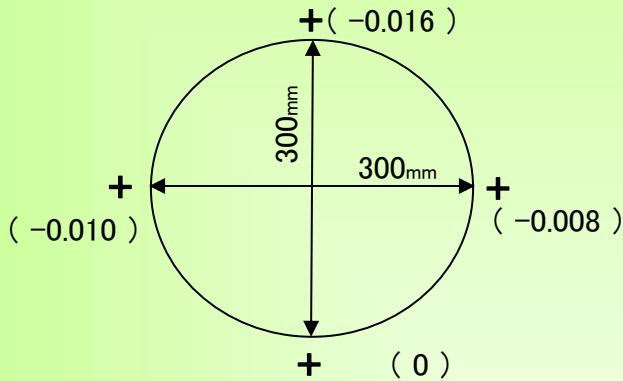

主軸振れ



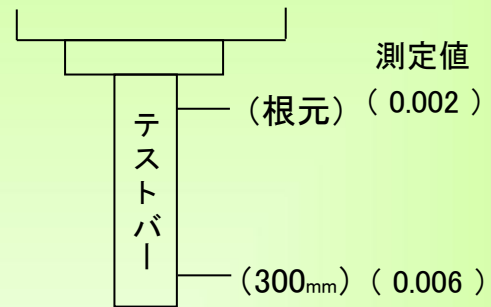


直角度

【YZ】測定値 (0.018)

【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.002)

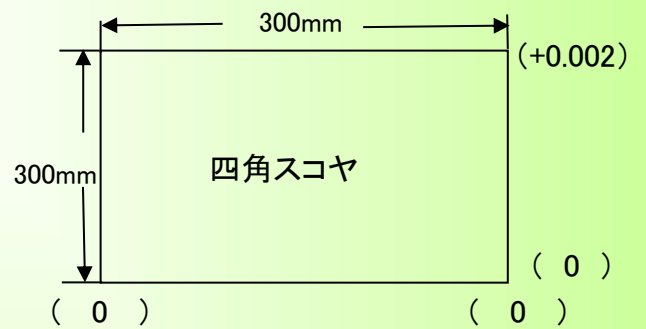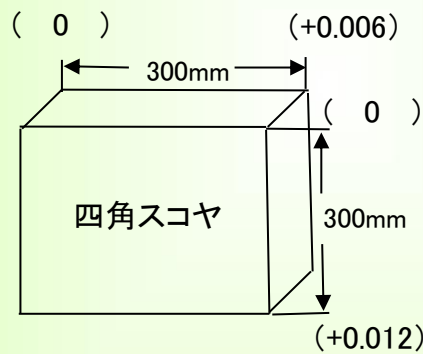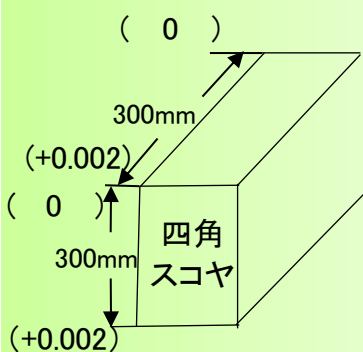


上面精度

※テーブルサイズ 1,000 × 460

220mm

160mm

※サブテーブル

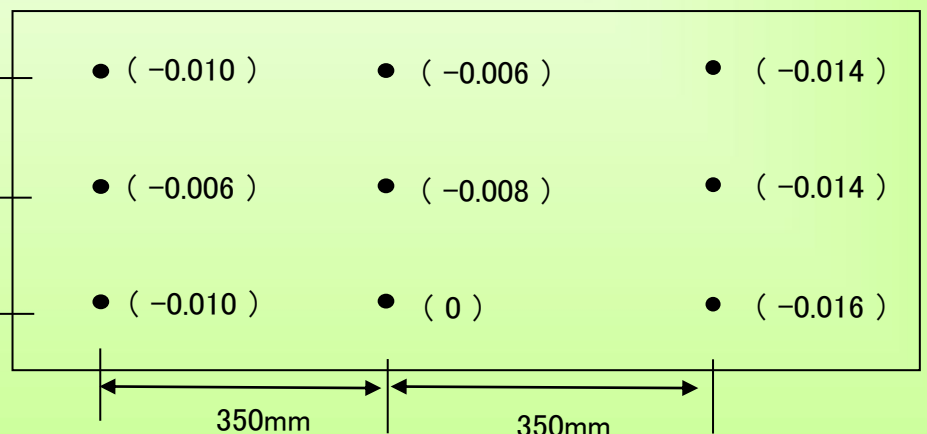

2026/6/4