


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	2013.10	管理番号	P009279
型式	D300	測定者	野辺沼	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

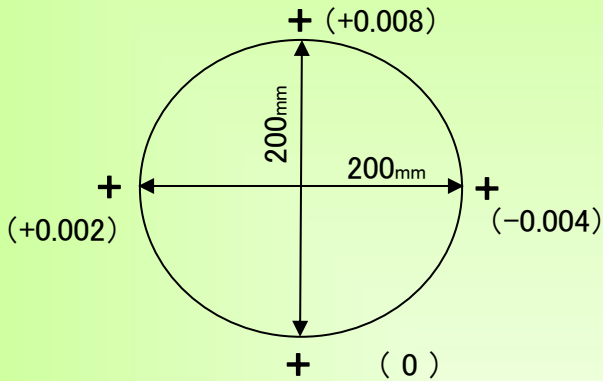

## 主軸振れ



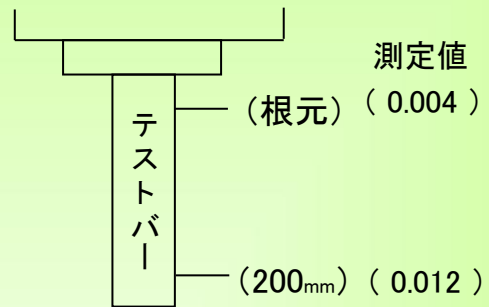


## 直角度

【YZ】測定値 (0.004)

【XZ】測定値 (0.004)


【XY】測定値 (0.010)

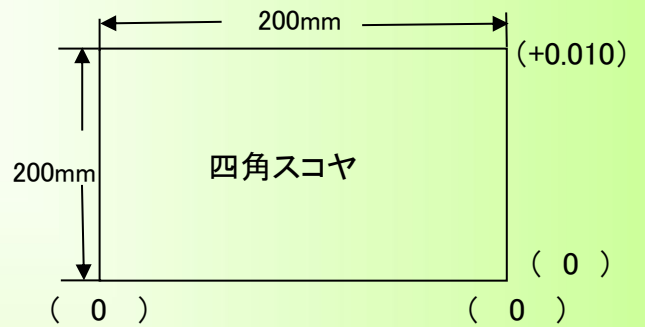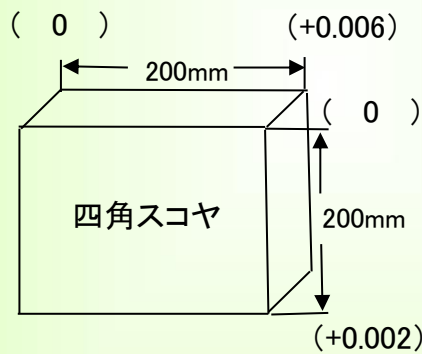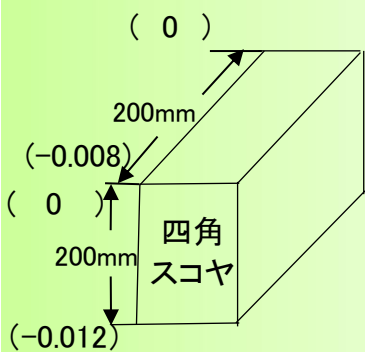

## 上面精度

[ ] → -90° ( ) → 0°

※テーブルサイズ 300Φ

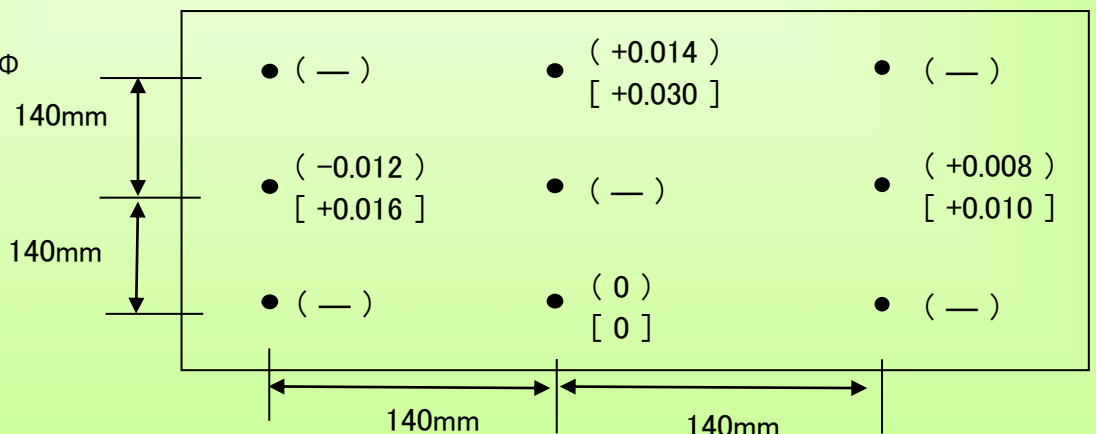

2026/6/9