


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2014.10	管理番号	P009262
型式	MP-46V	測定者	野辺沼	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

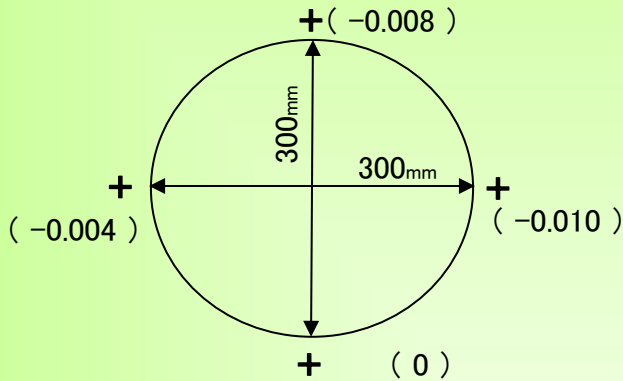

## 主軸振れ



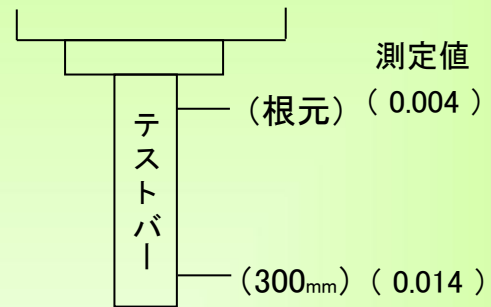


## 直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.006)

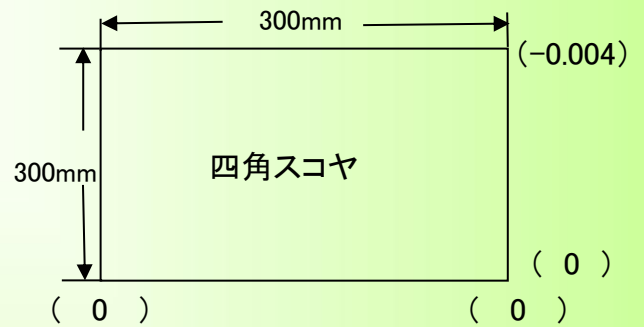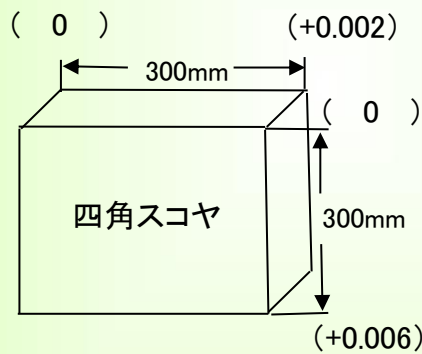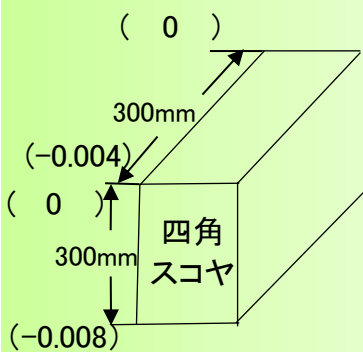

## 上面精度

※テーブルサイズ 760×460

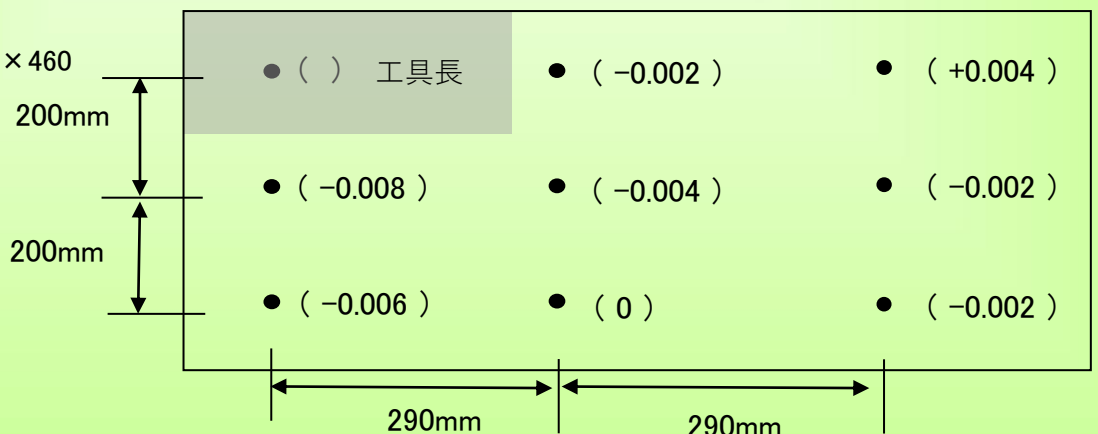

2026/6/8