


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	山崎技研	年式	2015	管理番号	H018205
型式	YZ-1121	測定者	平野	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

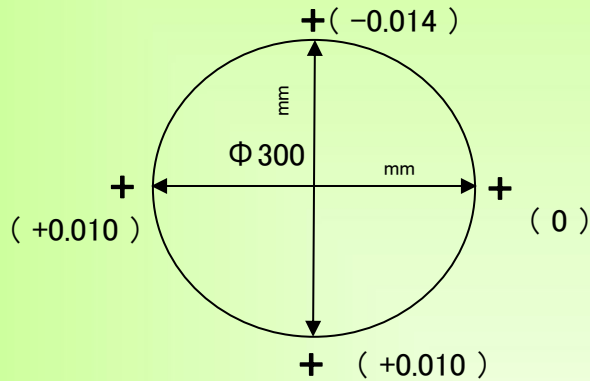

主軸振れ



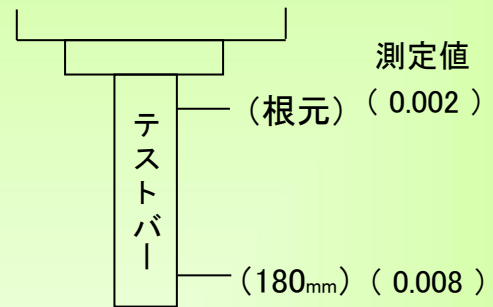


直角度

【YZ】測定値 (0.030)

【XZ】測定値 (0.016)

【XY】測定値 (0.014)

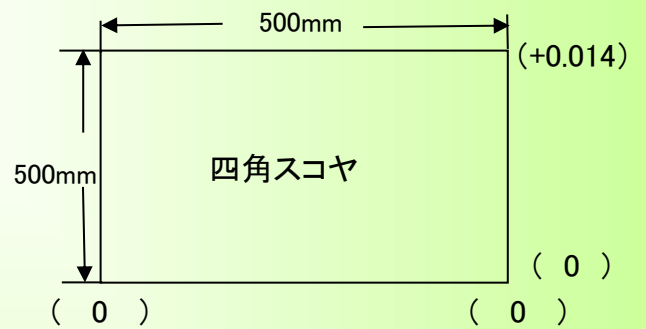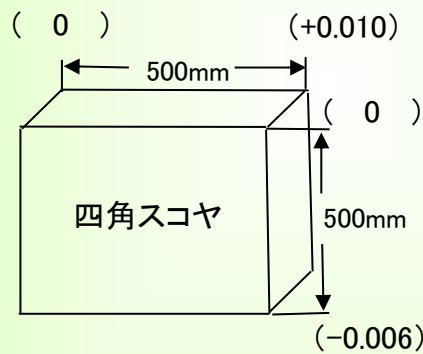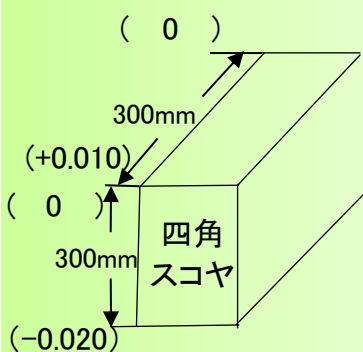

上面精度


※テーブルサイズ 920×2000

【バックラッシュ測定】

X軸 0.002

Y軸 0.002

Z軸 0.002

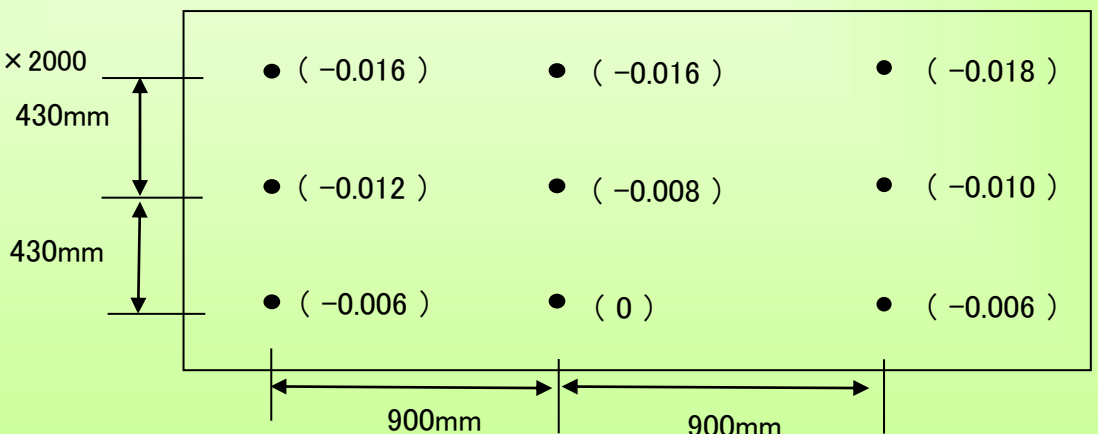

2026/6/11