


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	オークマ	年式	2009	管理番号	H018913
型式	MB-66VB	測定者	蔵内	アシスタント	仙田

## 振り回し(300ピッチ)

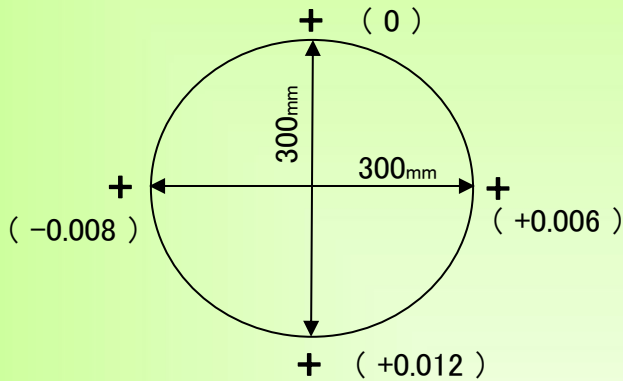

## 主軸振れ



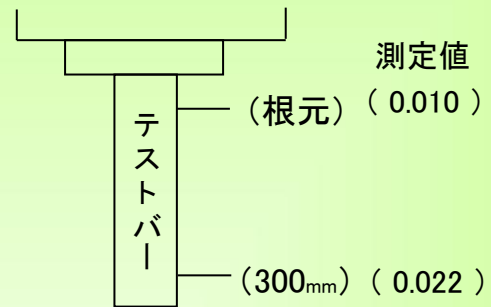


## 直角度

【YZ】測定値 (0.024)


【XZ】測定値 (0.012)

【XY】測定値 (0.006)

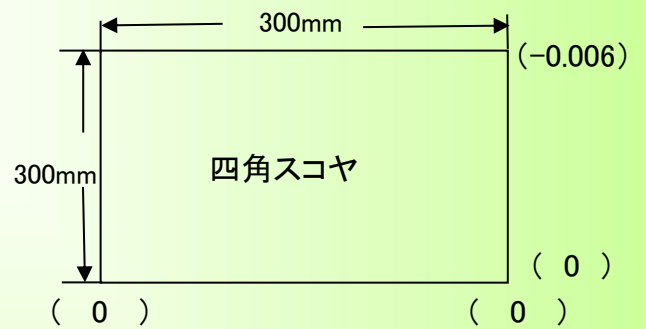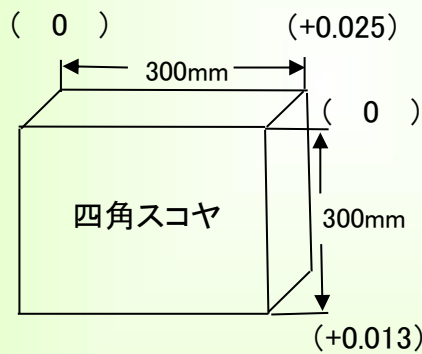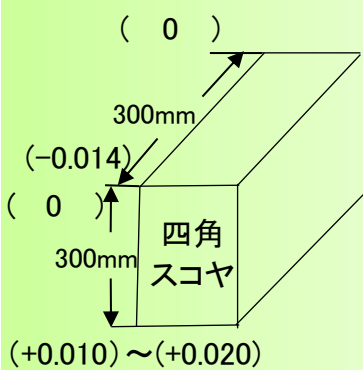

## 上面精度

※テーブルサイズ 1530×660

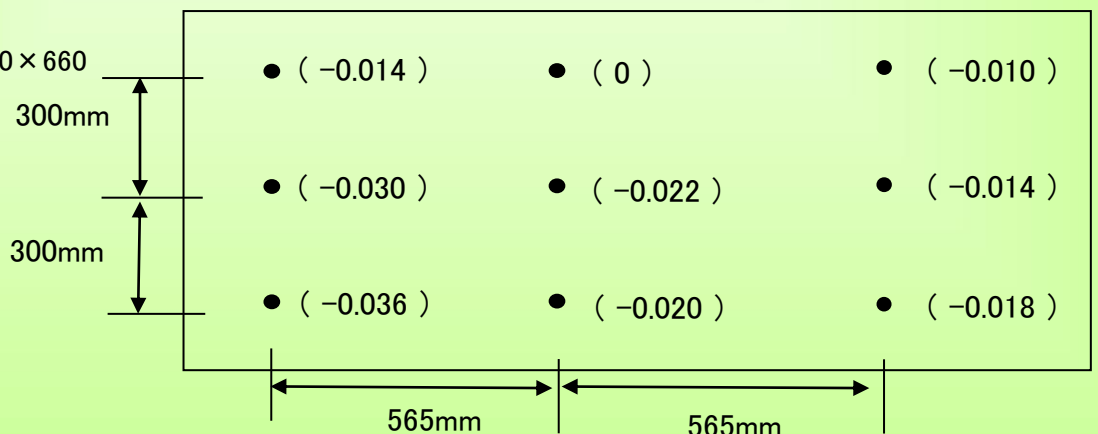

2026/6/18