


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	新日本工機	年式	2019	管理番号	G006065
型式	RB-3MII	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

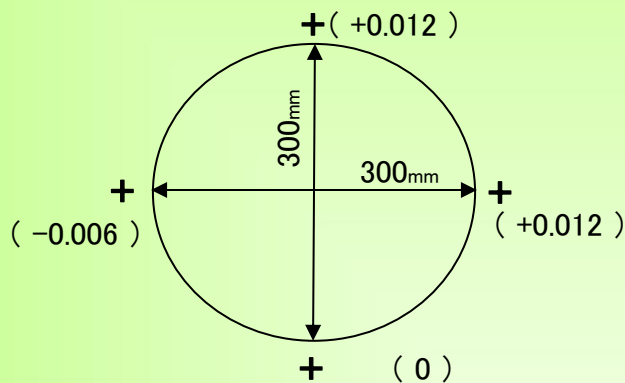

主軸振れ



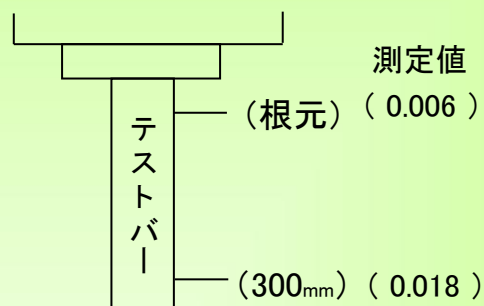


直角度

【XZ】測定値 (0.010)


【YZ】測定値 (0.008)

【X Y】測定値 (0.016)

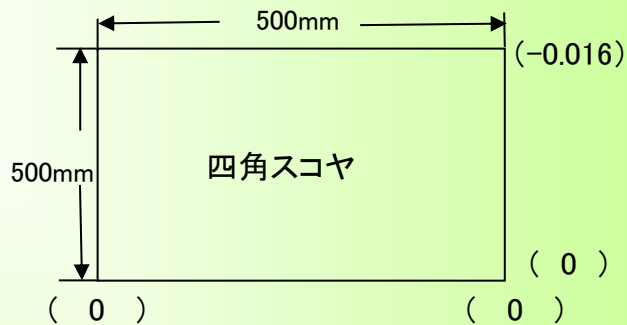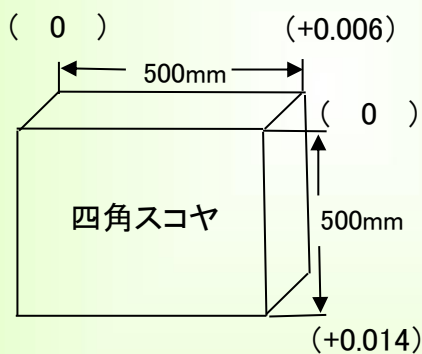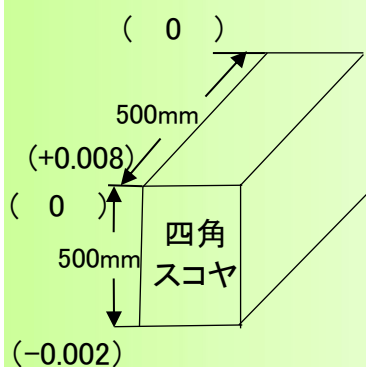

上面精度

※テーブルサイズ 1500 × 3000

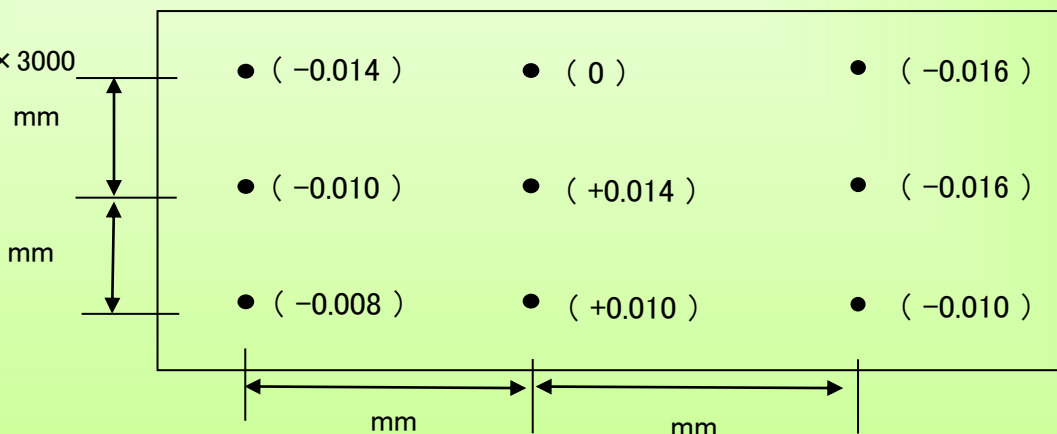

2026/6/17