
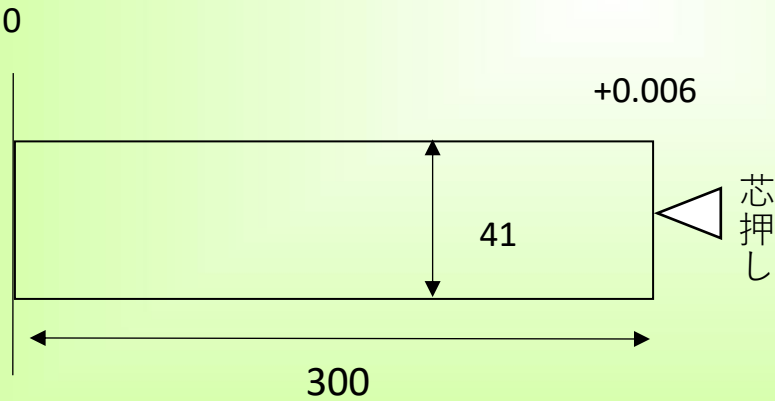


精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	滝沢	年式	2007	管理番号	H020100
型式	TAL-600	測定者	宮岡	アシスタント	

測定日 2026/6/30

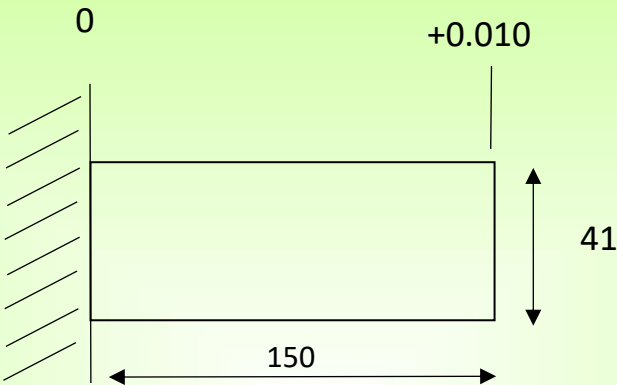

回転数 500 rpm
送り速度 0.14 mm/rev
切り込み 0.10 DIA