


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2008	管理番号	P009210
型式	α -T21iF	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

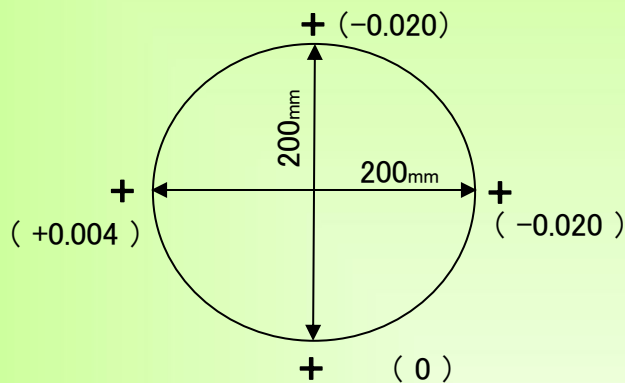

主軸振れ



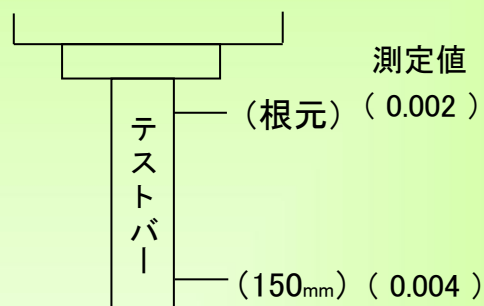


直角度

【YZ】 測定値 (0.002)

【XZ】 測定値 (0.012)

【X Y】 測定値 (0.004)

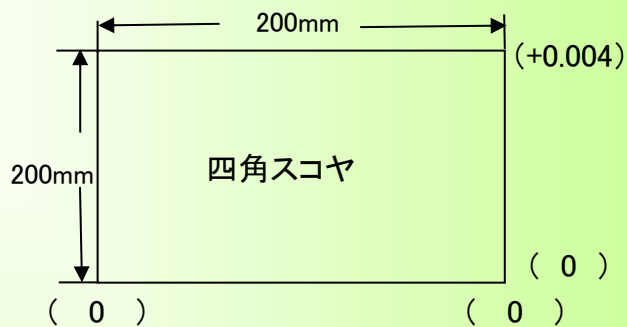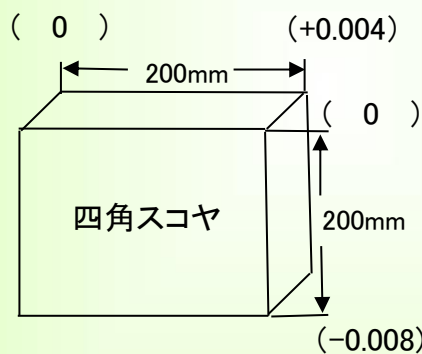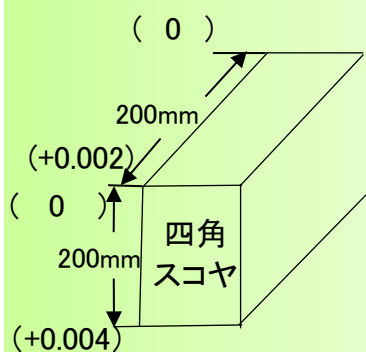

上面精度


【バックラッシュ測定】 X軸 0.002 Y軸 0.002 Z軸 0.002

※テーブルサイズ 400×650

【インデックス走り】

0° 0 → 0.014

90° 0 → 0.020

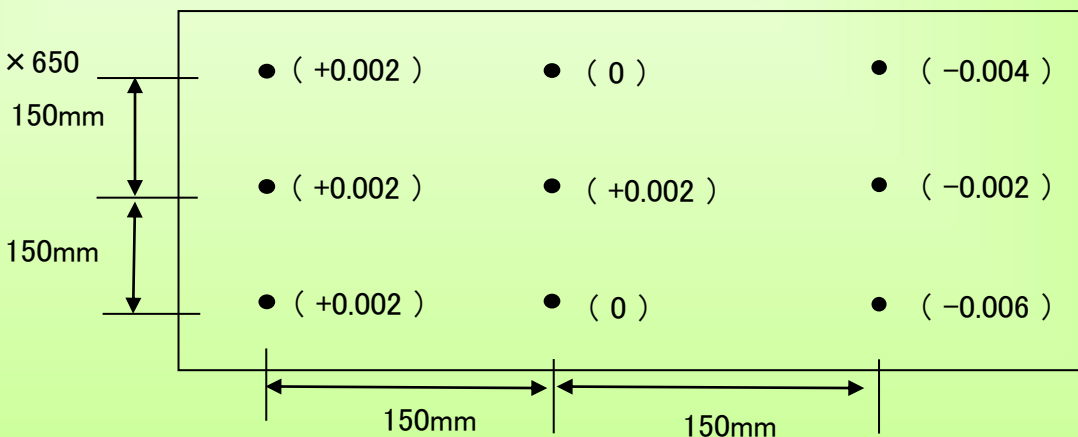

2026/7/1