


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ソディック	年式	2004	管理番号	P009242
型式	MC640L	測定者	近藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

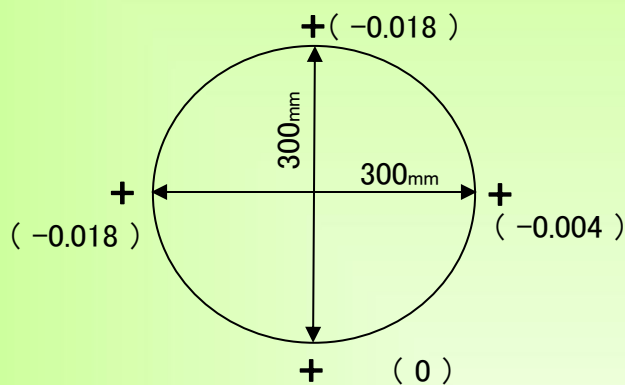

主軸振れ



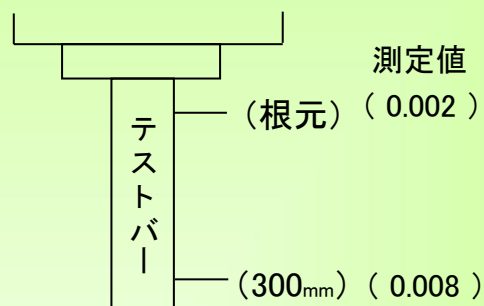


直角度

【YZ】 測定値 (0.002)


【XZ】 測定値 (0.002)

【X Y】 測定値 (0.002)

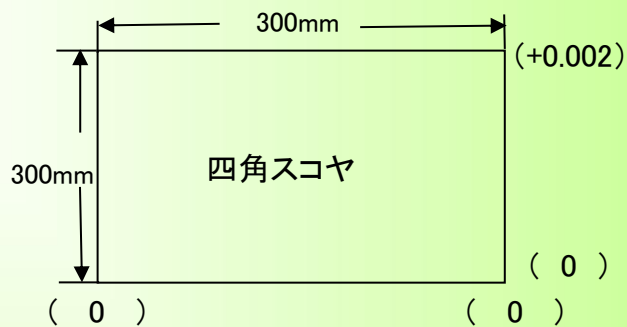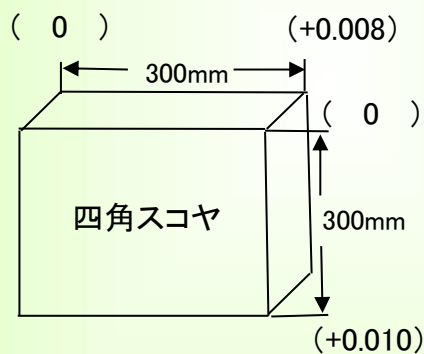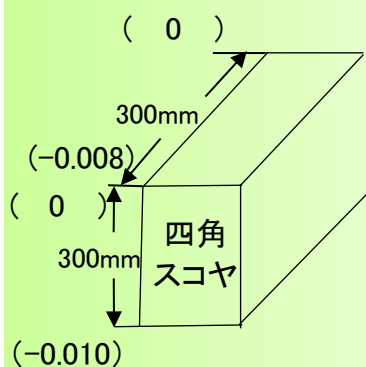

上面精度

※テーブルサイズ 750 × 400

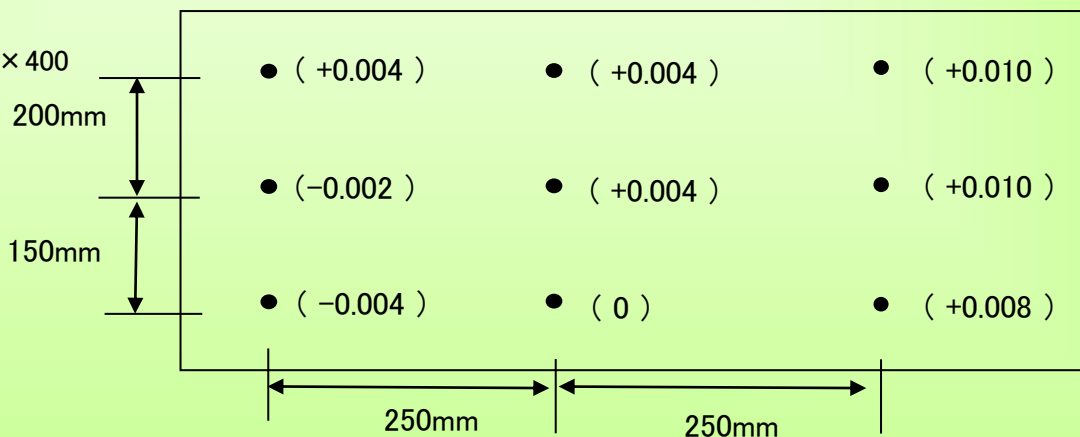

2026/7/21