
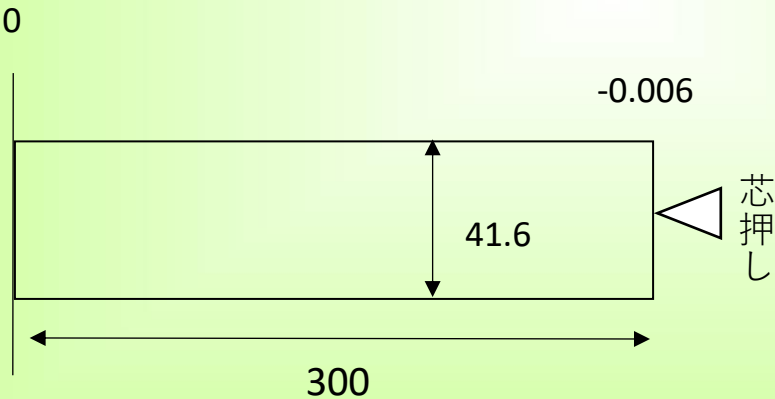


精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	滝沢	年式		管理番号	H020099
型式	TAL-460	測定者	宮岡	アシスタント	

測定日 2026/7/24

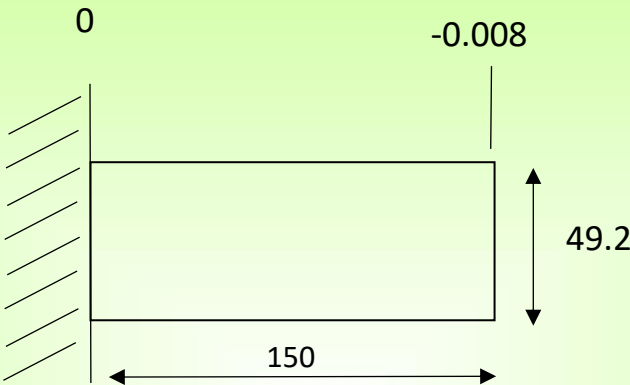

回転数 715 rpm
送り速度 0.106 mm/rev
切り込み 0.10 DIA