


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2008.1	管理番号	P009174
型式	MILLAC525H	測定者	金子	アシスタント	

Z軸方向の平行度

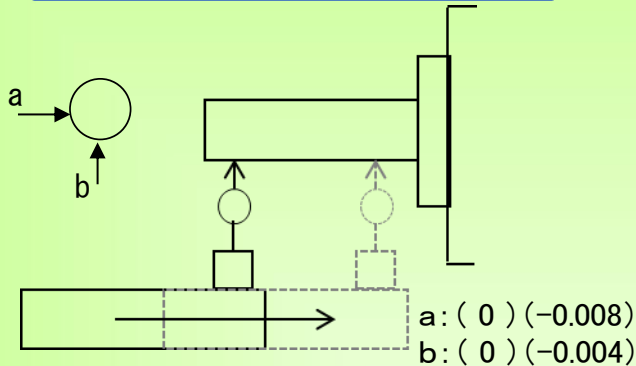

主軸振れ

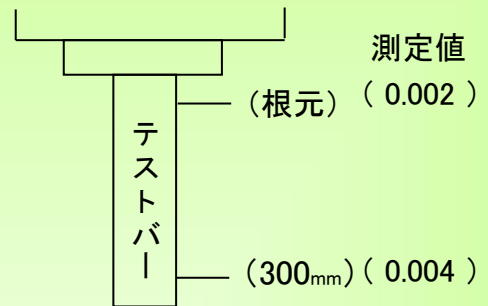



クランプ力 11.4kN

直角度

【XY】 測定値 (0.006)


【ZY】 測定値 (0.018)

【ZX】 測定値 (0.004)

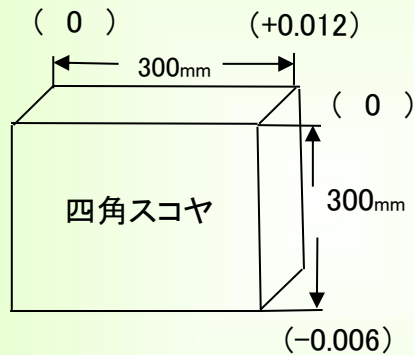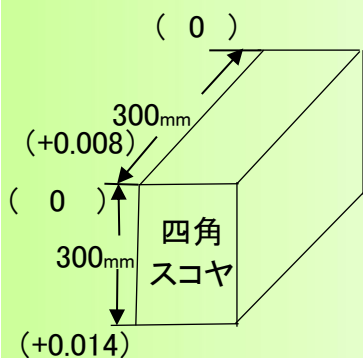

上面精度

テーブルサイズ: 400角
()パレット1
[]パレット2

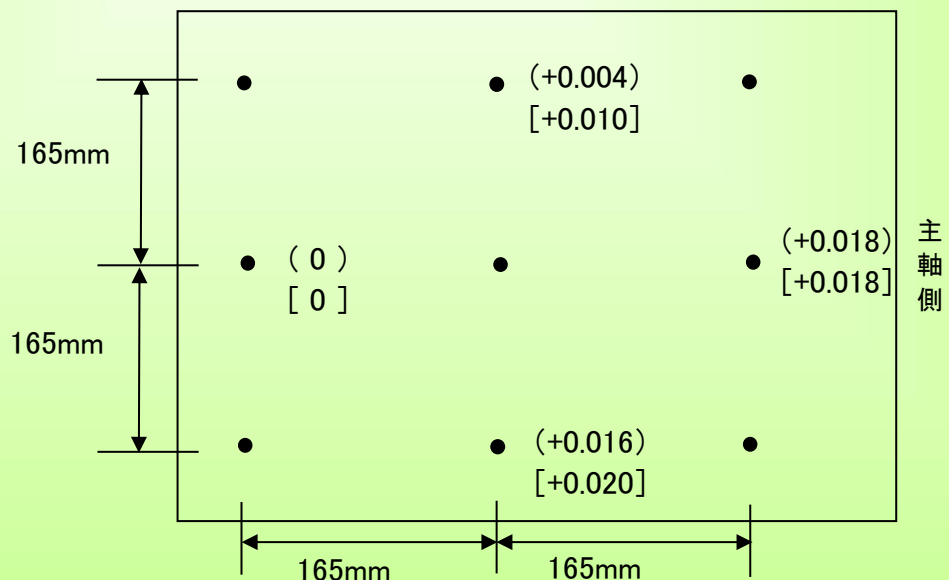

2026/7/25