


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2014	管理番号	H020027
型式	MILLAC-1052V II	測定者	蔵内	アシスタント	仙田

振り回し(300ピッチ)

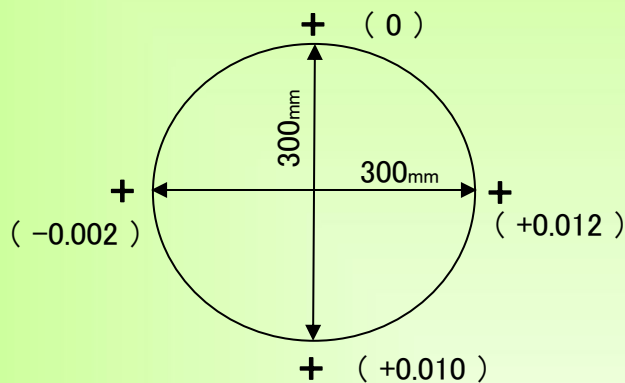

主軸振れ



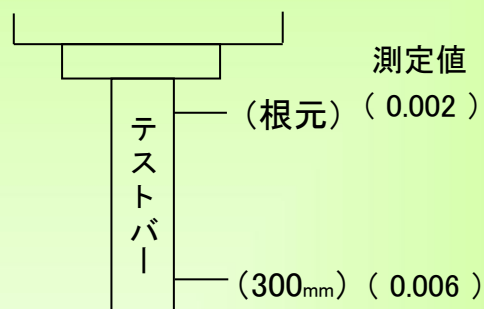


直角度

【YZ】測定値 (0.014)

【XZ】測定値 (0.016)

【X Y】測定値 (0.014)

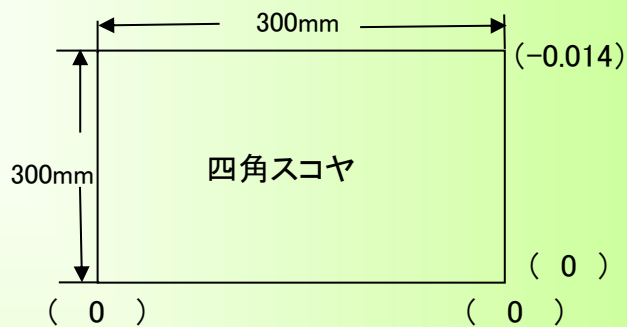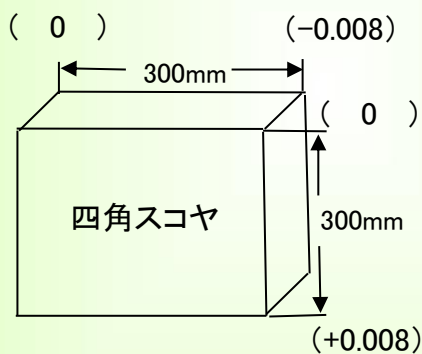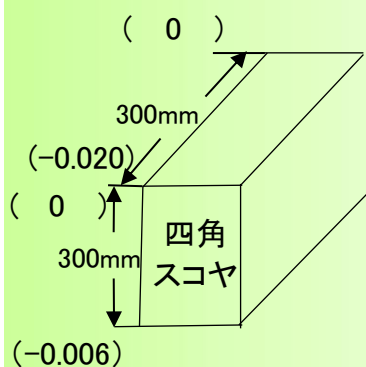

上面精度

※テーブルサイズ 2200×1050

500mm

500mm

● (-0.012)	● (0)	● (-0.008)
● (+0.014)	● (+0.018)	● (+0.018)
● (+0.008)	● (+0.020)	● (+0.020)

900mm

900mm

2026/8/3