


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2005	管理番号	P009328
型式	MILLAC-561V	測定者	野辺 沼	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

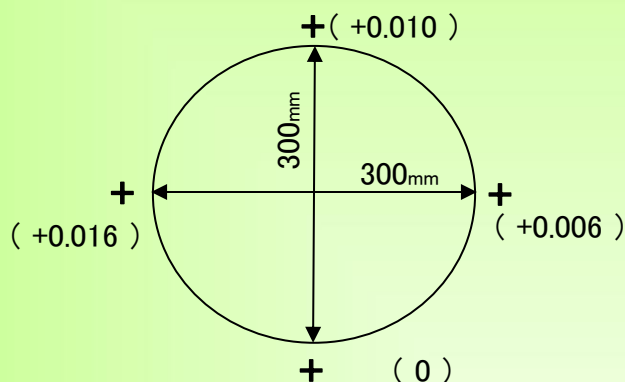

主軸振れ



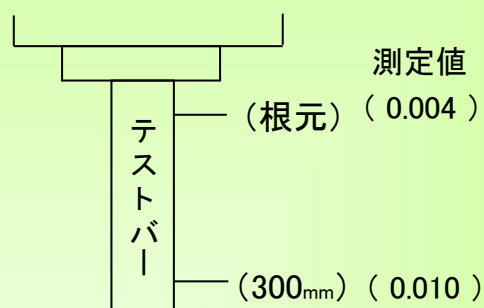


直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.006)

【X Y】測定値 (0.004)

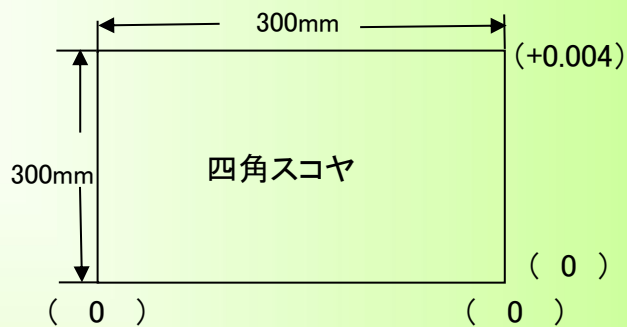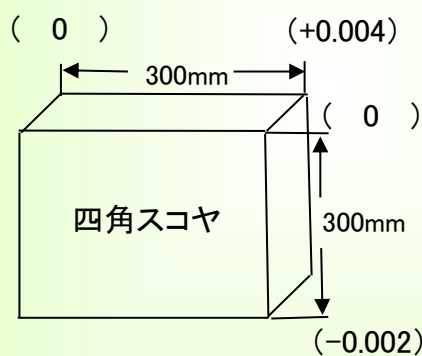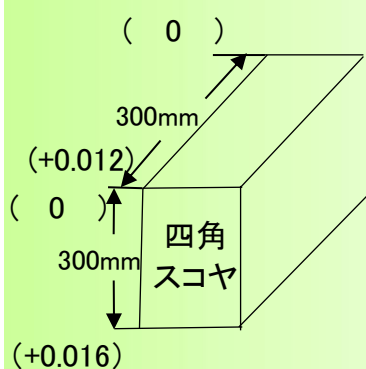

上面精度

※テーブルサイズ 1350×560

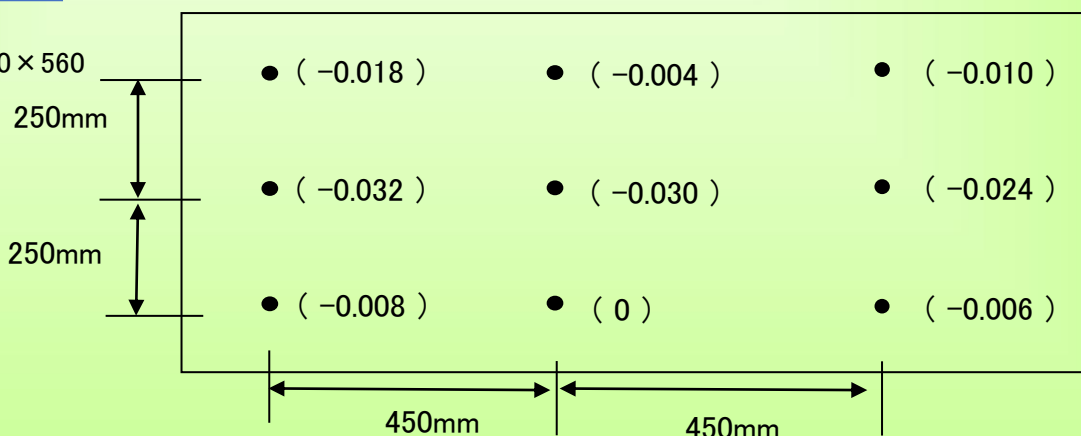

2026/8/6