


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2008	管理番号	P008752
型式	α -T21iF	測定者	近藤	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

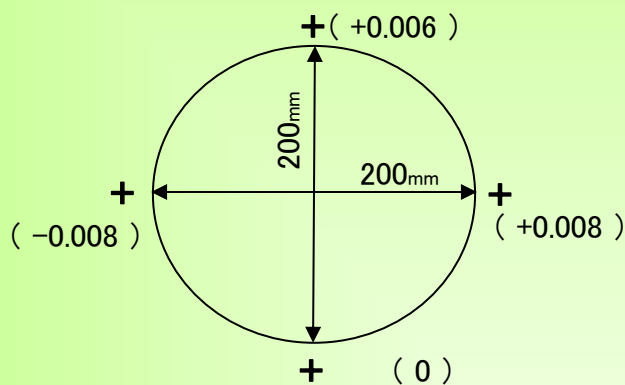

主軸振れ



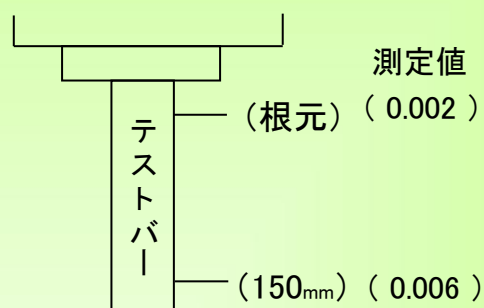


直角度

【YZ】測定値 (0.024)

【XZ】測定値 (0.012)

【X Y】測定値 (0.006)

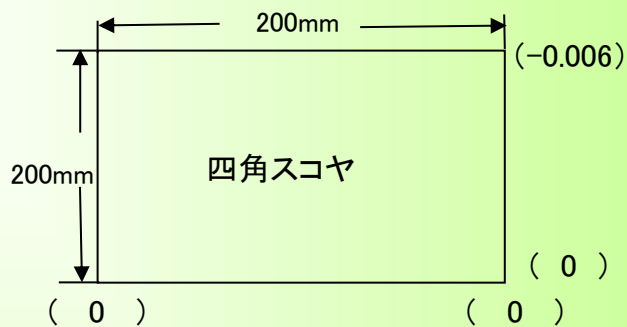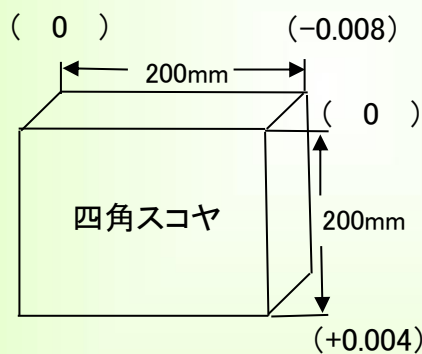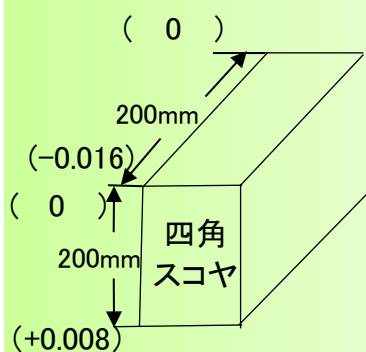


上面精度

工具長有

インデックス有

※テーブルサイズ 650 × 400

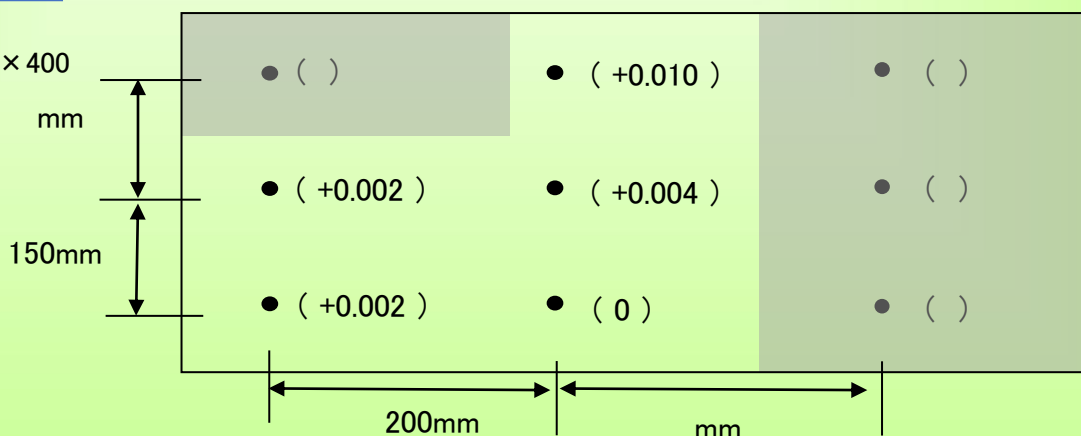

2026/8/21