


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2015	管理番号	G006060
型式	NVX7000/50	測定者	野辺 沼	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

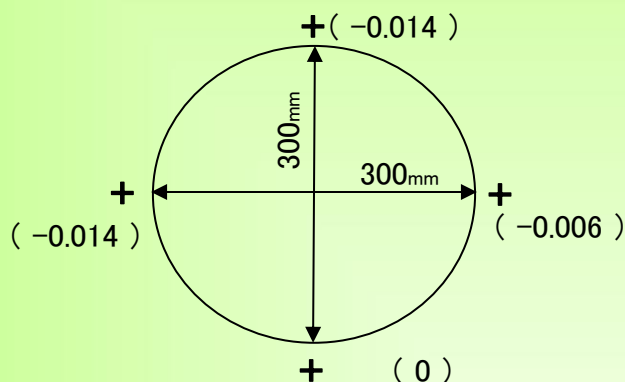

主軸振れ



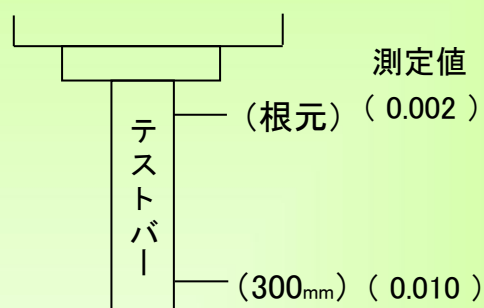


直角度

【YZ】測定値 (0.004)

【XZ】測定値 (0.006)

【X Y】測定値 (0.004)

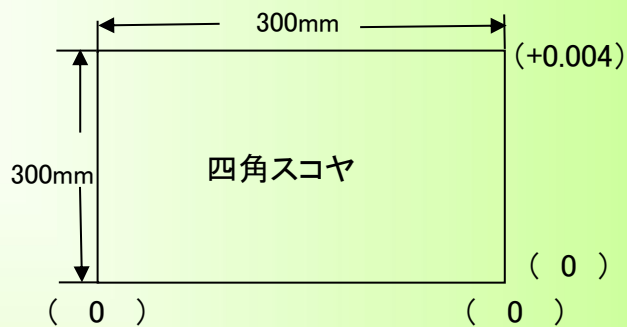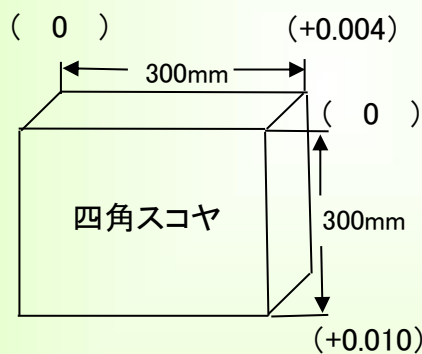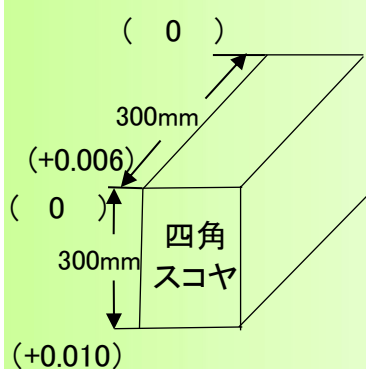

上面精度


※テーブルサイズ 1700×760

【バックラッシュ測定】

X軸 0.004

Y軸 0.006

Z軸 0.008

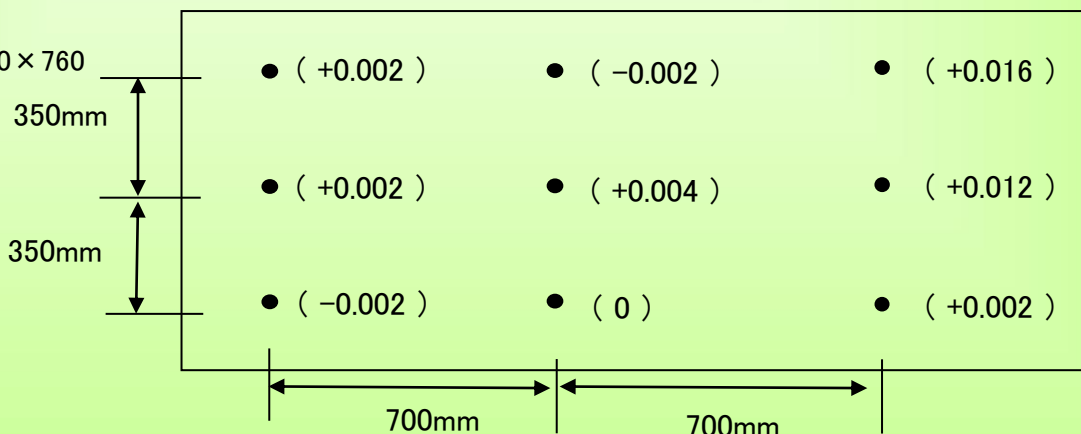

2026/8/29