


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ヤマザキマザック	年式	2012	管理番号	P008978
型式	VARIAXIS630-5X II	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

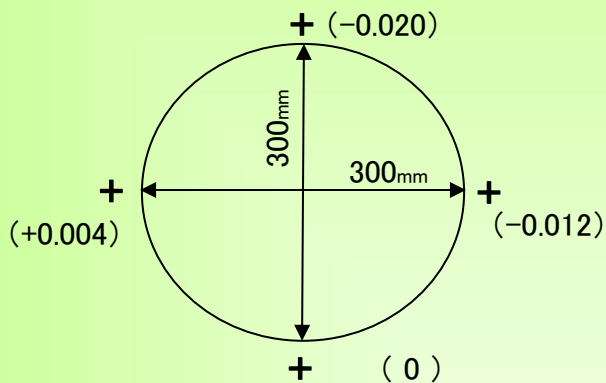

主軸振れ



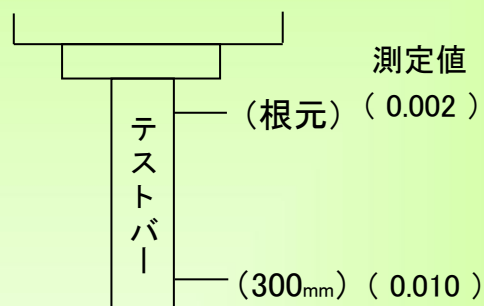


直角度

【YZ】測定値 (0.020)

【XZ】測定値 (0.004)

【X Y】測定値 (0.010)

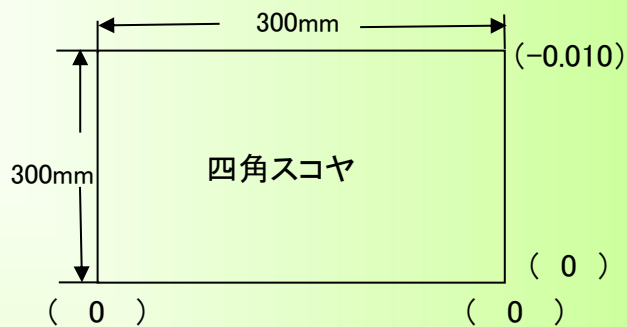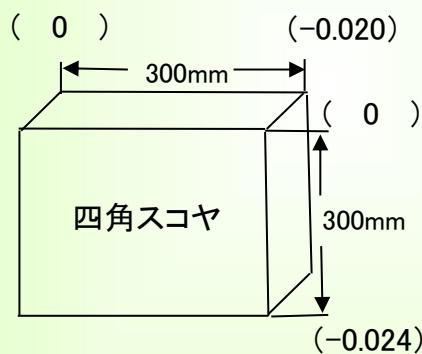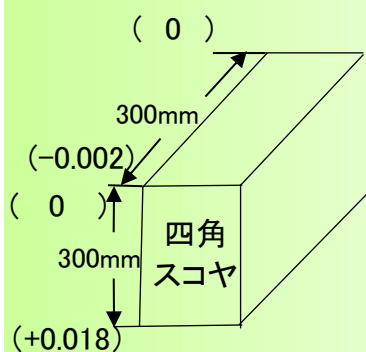


上面精度

[] → A軸-90° 【バックラッシュ測定】 X軸 0.002 Y軸 0.002 Z軸 0.002

※テーブルサイズ Φ630

NO.2	(+0.008)
	[-0.024]
(+0.028)	(0)
[-0.010]	[0]
(-0.002)	
[+0.008]	

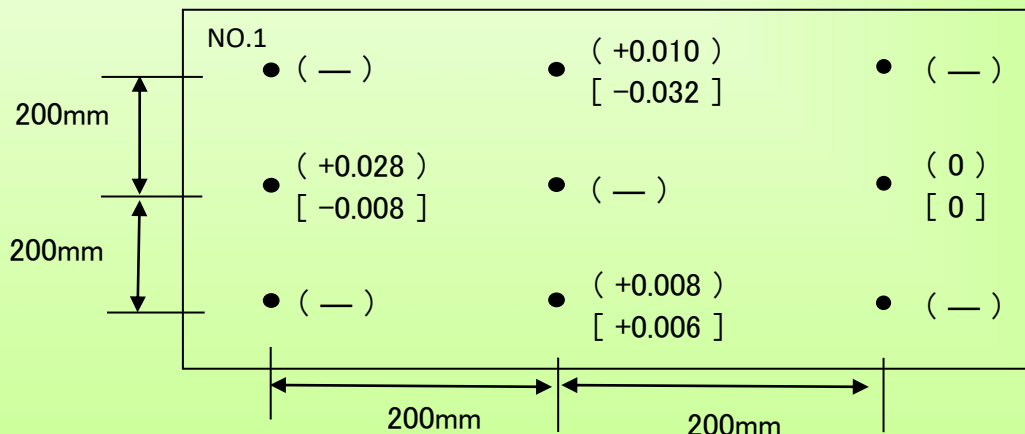

2026/9/4