


精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	滝沢	年式		管理番号	H020177
型式	TAL560×1500	測定者	宮岡	アシスタント	

測定日 2026/8/25

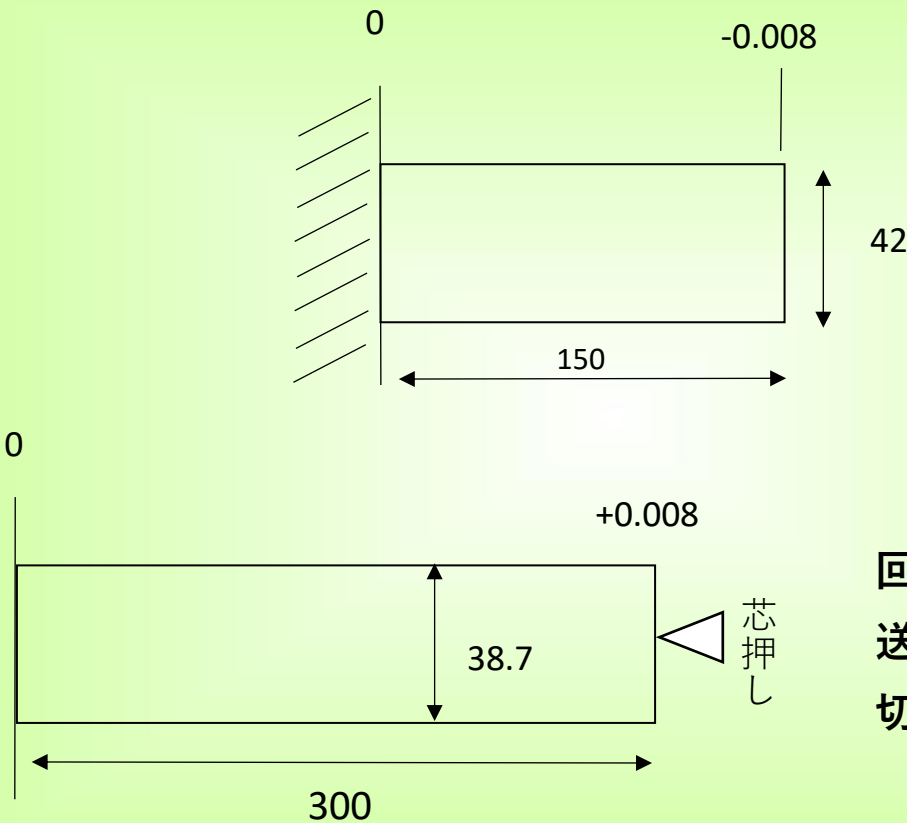

回転数 500 rpm
送り速度 0.106 mm/rev
切り込み 0.10 DIA