


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2008	管理番号	P009290
型式	α -T14iFS	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(150ピッチ)

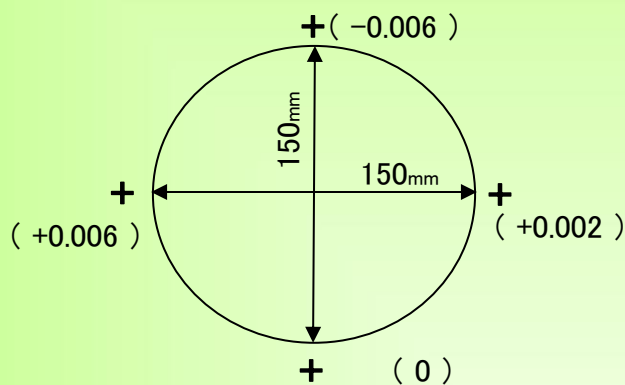

主軸振れ



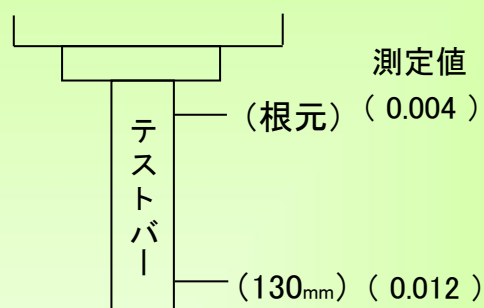


直角度

【YZ】測定値 (0.002)

【XZ】測定値 (0.008)

【X Y】測定値 (0.002)

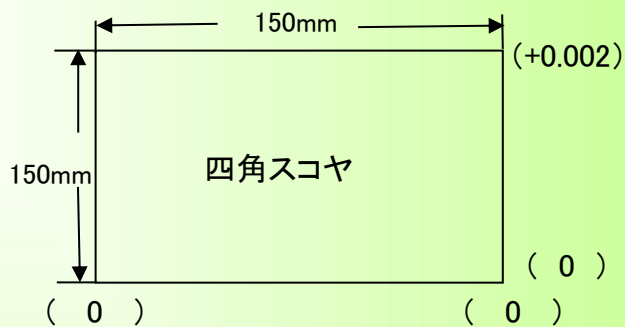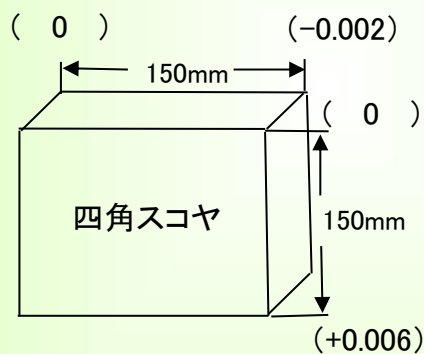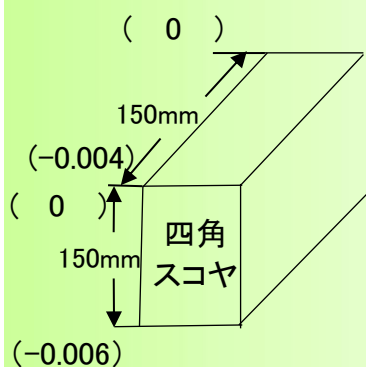


上面精度

※テーブルサイズ 630 × 330

110mm

80mm

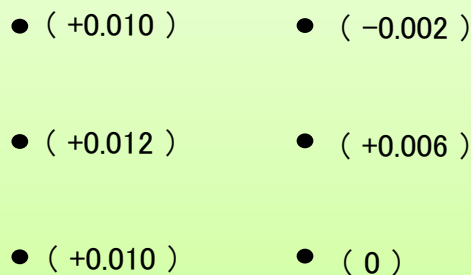

2026/9/5

90mm

90mm