


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2008	管理番号	P009291
型式	α -T14iFS	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(150ピッチ)

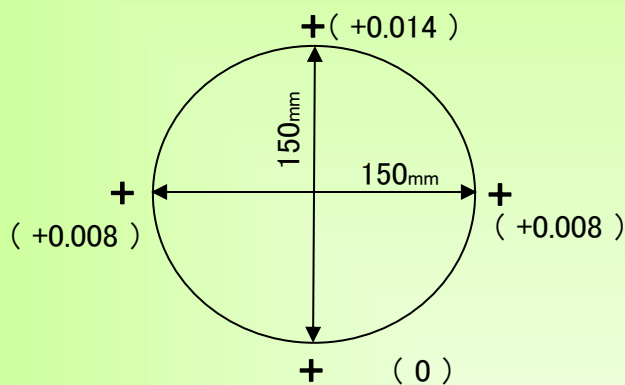

主軸振れ



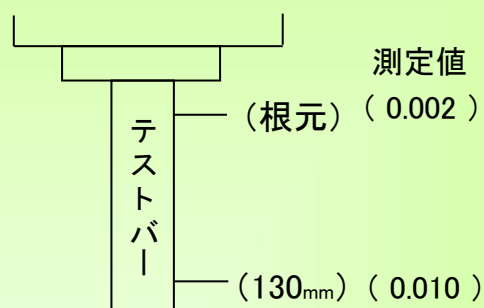


直角度

【YZ】測定値 (0.002)


【XZ】測定値 (0.004)

【X Y】測定値 (0.002)

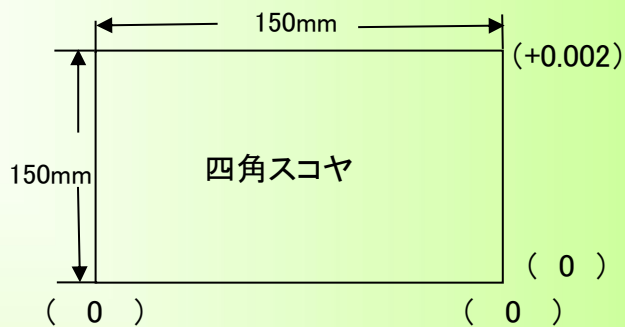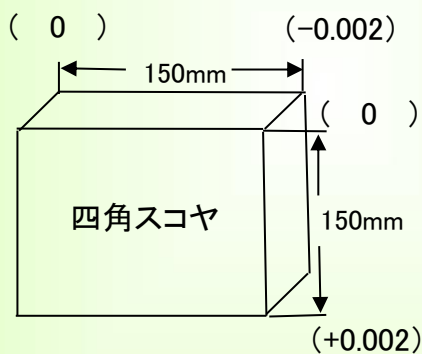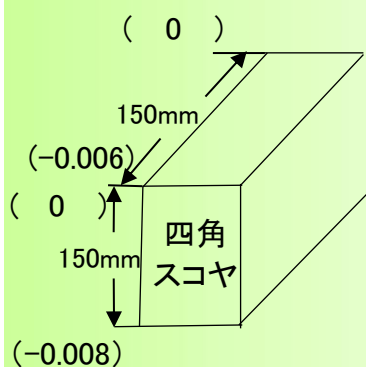

上面精度

※テーブルサイズ 630×330

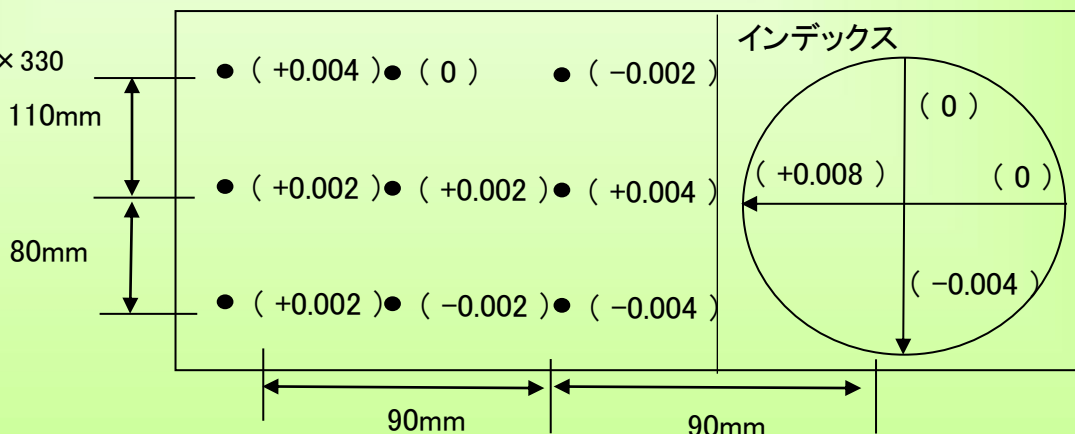

2026/9/5